



Stargard, 09.12.2020 r.

SZ.III-382/30.1/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 30/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie wyrobów medycznych i elementów narzędzi diagnostycznych w podziale na 31 pakietów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu 20, poz. 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 w pozycji 5 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w jedną strzykawkę luer-lock 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 26, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści łącznik anestezyjologiczny gładki wewnętrznie, z PCV, ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 22F, z podwójnym kapturkiem zatraskowym z uszczelnieniem do odsysania i bronchoskopii o długości 18cm, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 26, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści łącznik anestezyjologiczny dziecięco-noworodkowy, rozciągliwy z polipropylenu o długości 49-100mm ze złączami pacjenta 15F, złącze respiratora 15F, z portem 7,6mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 26, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180cm, dodatkowa rura do worka o długości 80- 100cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y bez portów, średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22F, łącznik prosty 22M/22M, z workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 2L, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu 26, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci, z rur rozciągliwych o długości 2m o rozciągnięciu, złącza 22F od strony respiratora, z trójnikiem i łącznikiem kątowym z portem do kapnografii (22M/15F), z dodatkową rurą do worka o długości 1,5m i workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 1 L oraz łącznikiem prostym 22M-22M do worka, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu 26, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora Bennett dla dorosłych o długości 160cm, sterylny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 7– dotyczy Pakietu 26, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora Bennett dla dorosłych o długości 160cm, mikrobiologicznie czysty, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8– dotyczy Pakietu 26, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora Bennett Acheva jednorurowy z rury gładkiej wewnątrznie z PCV o długości 160cm, z miękką końcówką, pułapką wodną, zastawką wydechową i dwoma liniami: jednym do monitorowania ciśnienia drugi do sterowania zastawką, oraz z dodatkową rurą gładką wewnątrznie z zakończeniami miękkimi o długości 0,5 m, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9– dotyczy Pakietu 26, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści linię do monitorowania gazu oddechowego o długości 3 m i śr. wew. 1,2mm, złącza męskie, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10– dotyczy Pakietu 26, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy dwulitrowy, mikrobiologicznie czysty, bezlateksowy jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11– dotyczy Pakietu 26, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o minimalnej objętości oddechowej >150ml, skuteczności filtracyjnej bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzonej niezależnymi protokołami testowymi, złącze proste 22F/15M-22M/15F, z portem do kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem na lince, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12– dotyczy Pakietu 26, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o minimalnej objętości oddechowej >180m, przestrzeni martwej 57ml, skuteczności bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzonej niezależnymi protokołami testowymi, złącze proste 22M/15F-22F/15M, z portem do kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem na lince, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13– dotyczy Pakietu 26, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, z centralnie umiejscowionym portem tlenowym, o minimalnej objętości oddechowej >60ml, przestrzeni martwej 19ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14– dotyczy Pakietu 27, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści komplet do inhalacji jednorazowego użytku pediatryczny z maseczką pediatryczną w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci, z nebulizatorem poj. 10ml, przy przepływie gazu



nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona, z drenem o przekroju gwiazdki – nie złamującym się- i długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15– dotyczy Pakietu 27, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 26 poz. 3 komplet do inhalacji jednorazowego użytku dla dorosłych z maseczką, nebulizatorem i drenem o przekroju gwiazdki o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16– dotyczy Pakietu 23, poz. 22:

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami posiadającymi technologię Masimo SET a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17– dotyczy Pakietu 23, poz. 22:

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 22 do odrębnego pakietu. Pozwoli nam to przygotować dla Państwa bardzo korzystną ofertę cenową na czujniki w technologii Masimo SET.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu 23:

Prosimy o wydzielenie pozycji 18 do oddzielnego pakietu co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości zamienników oryginalnych czujników Max-N.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19- dotyczy Pakietu 25, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stopem który zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta oraz posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania komora kroplowa dwuczęściowa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20- dotyczy Pakietu 25, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do 300ml możliwość obsługi jedną ręką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21- dotyczy Pakietu 25, poz. 3, 4, 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez uchwytu na dren i miejsca na igłę biorczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 22- dotyczy Pakietu 25, poz. 3, 4, 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez nazwy producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23- dotyczy Pakietu 25, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24- dotyczy Pakietu 25, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu w opakowaniu folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł blokowanych w dwóch pozycjach, długość całkowita 230 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy szczęk 1,8, 2,4 i 2,8 mm, długość robocza 160 cm i 230 cm, pancierz z markerami, pokryty tworzywem sztucznym ograniczającym tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, łyżeczki elipsoidalne standardowe lub wydłużone, z pojedynczym okienkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 3 zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20, 22 lub 25, 32 mm, kształty: owal, heksagonal, crescent, opcjonalnie – możliwość wykonania zimnej polipektomii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm, dostępne w długościach 165 i 230 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie siatek o rozmiarze 3 x 6 cm, płynna regulacja rozmiaru oparta na samohamowności uchwyty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia szczęk minimum 4,5 mm, wersja do kanału 2,8 – ząb szczura i szczęki aligatora (do wyboru), wersja pediatryczna – typ ząb szczura, korpus szczypiec bez znaczników.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 31- dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronnych, o długości 230 cm, średnica każdej z główek 6 mm, długość 20 mm oraz szczotek krótkich z główką o średnicy 5 mm i dł. 40 mm oraz średnicy 12 mm i dł. 60 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32- dotyczy treści SIWZ:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 3 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni licząc od daty powiadomienia o braku lub wadzie oraz uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwych towarów na pozbawione wad w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33- dotyczy treści SIWZ:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 2), 3):

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:
- 2) opóźnienia w dostarczeniu partii towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto partii zamówienia, z którego realizacją pozostaje w zwłoce, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za dzień oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii zamówienia;
- 3) opóźnienia w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii zamówienia, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za dzień, oraz łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34- dotyczy Pakietu 7, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści Poz. 1 średnica ostrza igły 19,22,25 G, długość ostrza 5 mm, długość całkowita 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35- dotyczy Pakietu 7, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści Poz. 2 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 1,8; 2,3mm i 3,0mm, długość robocza 180 i 230 cm, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36- dotyczy Pakietu 7, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści Poz. 3 Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza 230 cm; średnica osłonki 2,3mm; średnica otwartej pętli: 10,15,20,24,36mm.

Dostępne kształty: owal.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37- dotyczy Pakietu 7, poz. 4:

Czy zamawiający dopuści Poz. 4 Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i



zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 195 oraz 230cm, min. średnica kanału roboczego o 2.8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38- dotyczy Pakietu 7, poz. 5:

Czy zamawiający dopuści Poz. 5 Siatka do zbierania polipów, jednorazowego użytku, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; średnica pętli 30mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39- dotyczy Pakietu 7, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści poz. 6 Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, protez; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8mm lub 180 pediatryczne do kanału 2,0mm; szerokość otwarcia szczęk 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm; dostępność kształtu: ząb szczura i aligatora; pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. 2 systemem markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie, 1 opakowanie po 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40- dotyczy Pakietu 7, poz. 7:

Czy zamawiający dopuści Poz. 7 Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych. Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych: dwustronna, dł 230cm, śr. każdej z główek 5 mm i długości 20mm, śr. teflonowego cewnika 1,7mm. Szczotka krótka do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 i 11mm oraz długości 20 i 40mm. 50 opakowań po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41- dotyczy Pakietu 7, poz. 9:

Czy zamawiający dopuści Poz. 9 czterokomorowa pułapka na polipy. 4 opakowania po 25 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42- dotyczy Pakietu 23, poz. 10, 11:

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji elektrody jednorazowej EKG dla noworodka z kabelkiem zakończonym wtykiem 1,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 43- dotyczy Pakietu 23, poz. 10, 11:

Czy Zamawiający wymaga w powyższych pozycjach kompletu = 3 sztuki elektrod noworodkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 44- dotyczy Pakietu 23, poz. 18:

Prosimy o określenie wymaganego typu czujnika: klejowy czy bezklejowy (opaska z rzepem).

Odpowiedź: Obydwa typu czujnika są dopuszczone.

Pytanie nr 45- dotyczy projektu umowy §1 pkt. 5:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru,



czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46- dotyczy projektu umowy §1 pkt. 8:

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy Zamawiający wymaga np. układania towaru na półkach czy po prostu dostarczenia we wskazane miejsce tj. Magazyn medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli dostarczenie we wskazane miejsce tj. magazyn medyczny.

Pytanie nr 47- dotyczy Pakietu 19, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony ortopedycznej na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48- dotyczy Pakietu 19, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony ortopedycznej na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49- dotyczy Pakietu 19, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm, zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie i z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50- dotyczy Pakietu 19, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm



1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51- dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych o długości 20 m w stanie rozciągniętym o poniższych sposobach aplikacji:

- poz. 1 – „palec/paluch”
- poz. 2 – „dłoń/stopa”
- poz. 3 – „przedramię/ramię”
- poz. 4 – „głowa”
- poz. 5 – „tors dorosłego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52– dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 30 x 120 cm z dwoma mocującymi taśmami o wymiarach 9 x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53– dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 22 x 75 cm z dwoma mocującymi taśmami o wymiarach 9 x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54– dotyczy Pakietu nr 19, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
 - 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
 - 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 - 1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm
 - 1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).
- Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55- dotyczy Pakietu nr 19, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 56- dotyczy Pakietu 18:

Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie Nr 18 stosowany test ureazowy był wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź: Zgodnie SIWZ.

Pytanie nr 57- dotyczy Pakietu 11, poz. 1 i 2:

Czy w pakiecie 11 Zamawiający dopuści:

- w pozycji 1 – cewnik 11,5Fr X 19,5cm

- w pozycji 2 – cewnik 11,5Fr X 16cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58- dotyczy Pakietu 26, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnątrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm , dodatkowa rura do worka o dł. 120 cm, trójnik Y, kolanko z portem kapno, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59- dotyczy Pakietu 26, pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dzieci, materiał PCV, ramiona długości 120cm, gładki wewnątrznie, złącza 22mmF typu Flex, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii (15mmM-22mmM/15mmF), dodatkowe ramię dł. 120cm, worek oddechowy 1 litr, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60- dotyczy Pakietu 26, pozycja 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Filtra bakteryjno-wirusowy elektrostatycznego o objętości oddechowej 150-1200ml, przestrzeń martwa 51 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej>99,9998%, wirusowej >99,999%, złącze proste 22M/15F-22F/15M, z portem kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem, który nie będzie wyskakiwał przy wentylacji pacjenta, czas stosowania 24h, sterylny, w pojedynczym opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61- dotyczy Pakietu 26, pozycja 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 200-1500ml. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62- dotyczy Pakietu 1, poz.2 i 3:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63- dotyczy Pakietu 3:

Czy Zamawiający omyłkowo ponumerował pozycję 1,1,1,1 i winno być kolejno 1,2,3,4?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że winno być kolejno 1, 2, 3, 4.



Pytanie nr 64- dotyczy Pakietu 3, poz.1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 co umożliwi nam złożenie nowej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65- dotyczy Pakietu 3, poz.3:

Czy w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę medyczną w kształcie walca wyposażoną w gumkę umożliwiającą stabilne ułożenie na aparaturze 90x100 cm wykonaną z folii PE?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66- dotyczy Pakietu 3, poz.4:

Czy w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę medyczną w kształcie walca wyposażoną w gumkę umożliwiającą stabilne ułożenie na aparaturze 70x90 cm wykonaną z folii PE?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67- dotyczy Pakietu 10, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem na całej powierzchni, z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68- dotyczy Pakietu 10, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69- dotyczy Pakietu 10, poz. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70- dotyczy Pakietu 13, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu ocznego jałowego z wysokogatunkowej pulpy celulozowej z otuliną z włókniny, rozmiar 55 x 75mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71- dotyczy Pakietu 13, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonki w opakowaniu a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do 32 op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 72- dotyczy Pakietu 15, poz.2 i 3:

Czy w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do moczu dla niemowląt o pojemności 100 ml w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73- dotyczy Pakietu 17, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74- dotyczy Pakietu 17, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75- dotyczy Pakietu 19, poz. 3:

Czy w ww. pozycji Zamawiający opisując jedną z serwet 160x180 cm jako serwetę pomocniczą , ma na myśli serwetę samoprzylepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką serwetę, ale nie wymaga.

Pytanie nr 76- dotyczy Pakietu 24, poz.10:

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika 150 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77- dotyczy Pakietu 24, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika 2300ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78- dotyczy Pakietu 24, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika 11000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79- dotyczy Pakietu 30, poz. 1-2:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80- dotyczy Pakietu 30, poz. 3:

Czy w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie do cewnikowania pęcherza moczowego 1x pęseta plastikowa anatomiczna 13,0 cm, 1x serweta barierowa włókninowa, nieprzylepna 50 x 75 cm, 1x serweta barierowa, włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem średnicy 7 cm, woda sterylna w dwóch ampułkach 2x ampułka 10 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia papier z dodatkowo dołączonym plastikowy pojemnikiem nerkowatym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81- dotyczy Pakiet 30, poz. 5:

Czy w ww. pozycji Zamawiający ma na myśli w serwecie 75x90 cm z boczną krawędzią przylepną z otworem, - przylepic wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli bez przylepca wokół otworu.

Pytanie 82- dotyczy Pakietu 31, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt lampy pakowaną pojedynczo w opakowaniu typu folia-podfoliowany papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83- dotyczy Pakietu 31, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się samoprzylepne naklejki do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 84- dotyczy Pakietu 31, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne osłonki na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych umożliwiające wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności. Osłonka jednorazowa posiada kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy.

Wysokość samego uchwytu: 8 cm

Wysokość całkowita: 8,5 cm


Średnica otworu: 3 cm

Średnica kołnierza: 13 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 85- dotyczy Pakietu 31, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

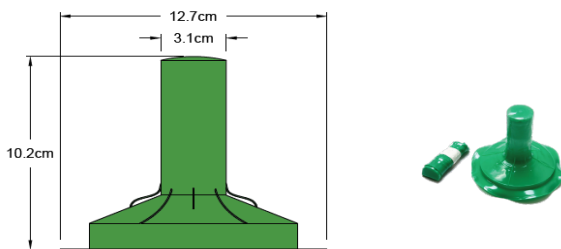

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 86- dotyczy Pakietu 31, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m². Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem z przeliczeniem podanych ilości. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 87- dotyczy Pakietu 31, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m². Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem z przeliczeniem podanych ilości. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 88- dotyczy Pakietu 31, poz. 6:

Czy w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89- dotyczy Pakietu 31, poz. 7:

Czy w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków wymiennych kompatybilnych z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 90- dotyczy treści SIWZ, część V., pkt 4:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna zapis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku



postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną w pytaniu interpretację zapisów.

Pytanie nr 91- dotyczy treści SIWZ, część XI., pkt 1. ppkt. 4):

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerowania stron, oferta jest składana w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92- dotyczy treści SIWZ, Część XVIII., pkt 5, ppkt. 1) oraz załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa § 11 ust. 3, pkt. 1):

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób: „zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia”. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, czy stawka podatku VAT ulegnie podwyższeniu i niezasadne jest aby wziął na siebie ryzyko utraty części wynagrodzenia z powodu podniesienia stawki podatku VAT. Brak zgody Zamawiającego spowoduje wzrost cen netto wyrobów medycznych już na etapie składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93- dotyczy Pakietu 14, pozycja 1 i 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrichmedical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 94- dotyczy Pakietu 14, pozycja 1 i 2:

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalanydietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.



Pytanie nr 95- dotyczy treści SIWZ: Załącznik nr 2– Umowa §2 ust. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: §2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Dostawy produktów, o których mowa w §1 ust. 1 odbywać się będą partiami, na podstawie zamówień składanych telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, Zamawiający potwierdzi za pomocą poczty elektronicznej złożenie zamówienia, w kolejnym dniu roboczym.

Pytanie nr 96- dotyczy treści SIWZ- Załącznik nr 2 – Umowa §6 ust. 6 oraz § 4 ust. 1:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby faktura była wystawiona w dniu wysyłki towaru i dostarczona w wersji pisemnej wraz z towarem, po każdym zamówieniu. Wykonawca dodatkowo dołączy do wysyłki dwa protokoły odbioru. Zamawiający, jeżeli nie stwierdzi wad ilościowych, odsyła podpisany protokół.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97- dotyczy Pakietu 6, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy o wymiarze otworu głównego 21 mm x 26,5 mm przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 98- dotyczy Pakietu 6, pozycja 4:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4 z Pakietu 6 i utworzy z niego oddzielny Pakiet? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

Pytanie nr 99- dotyczy Pakietu 26, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, wykonany z materiału EVA, z rurami karbowanymi obustronnie i dodatkową rurą o długości 100 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100- dotyczy Pakietu 26, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, wykonany z materiału EVA, z rurami karbowanymi obustronnie o długości 160 cm i dodatkową rurą o długości 80 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101- dotyczy Pakietu 26, pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, wykonany z materiału EVA, z rurami karbowanymi obustronnie przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102- dotyczy Pakietu 26, pozycja 5:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 5 z Pakietu 26 i utworzy z niego oddzielny Pakiet? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

Pytanie nr 103- dotyczy Pakietu 26, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści linię do pobierania próbek o długości 305 mm przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę. W Pakiecie 26, poz. 6 jest napisane 300 mm, winno być 300 cm. Jeśli Oferent miał na myśli 305 cm, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104- dotyczy Pakietu 26, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty worek oddechowy przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105- dotyczy Pakietu 26, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106- dotyczy Pakietu 26, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M



- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107- dotyczy Pakietu 26, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108- dotyczy Pakietu 31, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę o parametrach:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 17cm x 24,5 cm
- Gramatura 100g/m²- część przednia pokryta mydłem, 70g/m²- część tylna bezmydła
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109- dotyczy Pakietu 31, pozycja 5:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 5 z Pakietu 31 i utworzy z niego oddzielny Pakiet? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.



Pytanie nr 110- dotyczy Pakietu 26, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści linię do pobierania o dł 300 cm (3m) . Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieją linie o dł. 300 mm tj 30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111- dotyczy Pakietu 26, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści linie do pobierania próbek gazów czystą mikrobiologicznie, zaznaczamy iż jest to wyrób medyczny dopuszczony do używania przez podmioty medyczne. Posiada jako wyrób medyczny certyfikat CE, Deklarację zgodności i jest zgłoszony do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112- dotyczy Pakietu 26, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o poj. 2 litrów czysty mikrobiologicznie, zaznaczamy, iż jest to wyrób medyczny dopuszczany do używania przez podmioty medyczne. Posiada jako wyrób medyczny certyfikat CE, Deklarację zgodności i jest zgłoszony do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113- dotyczy Pakietu 26, poz. 8, 9:

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji wirusowej >99,999% przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114- dotyczy Pakietu 27, poz. 1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenów o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 115- dotyczy Pakietu 28:

Czy Zamawiający wymaga masek z otwartym mankietem, wykonanych w całości z przezroczystego materiału umożliwiający zaobserwowanie krwawienia, wymiocin lub oddechów spontanicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 116- dotyczy Pakietu 9 poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści elastyczny dziany rękaw opatrunkowy przeznaczony odpowiednio na:

Poz. 2: dłoń, przedramię, stopa, łokieć,

Poz. 3: ramię, podudzie, kolano, stopa,

Poz. 4: udo, głowa,

Poz. 5: klatka piersiowa, brzuch.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117- dotyczy Pakietu 13 poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 118- dotyczy Pakietu 13 poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie kompresu ocznego w rozmiarze 5cm x6cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119- dotyczy Pakietu 17 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe gdzie utrata gipsu podczas namaczania wynosi 0,8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120- dotyczy Pakietu 19 poz.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 30x80cm z taśmą lepłą 9x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 121- dotyczy Pakietu 19 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawu serwet o następującym składzie:

- SERWETA Z LAMINATU DWUWARSTWOWEGO W ROZM. 300X180CM Z OTWOREM W ROZM. O35X32 Z FOLIĄ

CHIRURGICZNĄ I WORKIEM

- KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM

- POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI

- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM

- PODKŁAD SENI SOFT BASIC 90X60CM

opakowanie TOREBKA PAPIEROWO-FOLIOWA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 122- dotyczy Pakietu 19 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawu serwet o następującym składzie:

SERWETA 320X180CM O35X32 Z WORKIEM I FOLIĄ CHIRURGICZNĄ (serweta o gramaturze 56g),

SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 80X60CM,

POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,

TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 123- dotyczy Pakietu 19 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawu serwet o następującym składzie:

SERWETA 320X180CM O35X32 WOR FOLIA CHIR (serweta o gramaturze 56g),

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM,

POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,

PODKŁAD SENI SOFT BASIC 90X60CM.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 124- dotyczy Pakietu 19 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet o następującym składzie:
SERWETA 325X250CM O35X32 WORKIEM I FOLIĄ CHIRURGICZNĄ (serweta o gramaturze 73g/m2),
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM,
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,
PODKŁAD SENI SOFT SUPER 90X60CM.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125- dotyczy Pakietu 19 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet o następującym składzie:
SERWETA 270X200CM O35X32 WORKIEM, ZINTEGROWANYMI NOGAWICAMI (serweta o gramaturze 73g/m2),
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM,
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126- dotyczy Pakietu 19 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet o następującym składzie:
SERWETA 325X250CM Z OTWOREM: O35X32, Z WORKIEM I FOLIĄ CHIRURGICZNĄ (serweta o gramaturze 73g/m2),
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM,
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,
CZAPECZKA DLA NOWORODKA BAWĘLNA 100% ROZMIAR 38,
KOCYK FLANELOWY 160X75CM,
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 127- dotyczy Pakietu 19 poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet o następującym składzie:
SERWETA 300X240CM Z OTWOREM WIELKOŚCI: O4 I ELEMENTEM ELASTYCZNYM (serweta o gramaturze 73g/m2),
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM,
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 128- dotyczy Pakietu 19 poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu serwet o następującym składzie:
POKROWIEC NA KOŃCZYNE 80X45CM,
SERWETA 300X240CM Z OTWOREM O4 I ELEMENT EL (serweta o gramaturze 73g/m2),
SERWETA 200X150 CM,



KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM,
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI,
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM,
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 129- dotyczy Pakietu 31, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku, gotowej do użycia po aktywacji wodą, zgrzewanej termicznie. Myjka hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniyny podfoliowanej wewnątrz. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równoległe ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. W opakowaniu jednostkowym 20 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130- dotyczy Pakietu 27, poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaferowane produkty mają być pozbawione szkodliwych ftalanów, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131- dotyczy Pakietu 27, poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zaferowane produkty posiadały na opakowaniu jednostkowym: nazwę, grafikę produktu z opisem, nr katalogowy, producent, datę ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132- dotyczy Pakietu 25, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu do przetoczeń z jednoczęściową komorą kropłową? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133- dotyczy Pakietu 25, poz. 3,4,5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu do przetoczeń bez logo producenta na zaciskaczu? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 134- dotyczy Pakietu 4, poz. 5:

Czy Zamawiający przez „Zestaw do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm” rozumie Zgłębnik jelitowy Flocare Bengmark PEG/J CH 9/105 cm?

Odpowiedź: Zamawiający tak to rozumie.

Pytanie nr 135- dotyczy Pakietu 15, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 136- dotyczy Pakietu 15, poz. 2-3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137- dotyczy Pakietu 15, poz. 2-3:

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138- dotyczy Pakietu 25, poz. 3-5:

Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 139- dotyczy Pakietu 25, poz. 4-5:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 140- dotyczy Pakietu 25, poz. 3-5:

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk**