



Nasz znak: DEA.ZP-291/12/2020

Łódź, dn. 3 grudnia 2020 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Dot. pkt. 88 załącznika nr 1 do SIWZ.

Prosimy o informację, czy szafka z szufladami, zamontowana w przedziale medycznym (na ścianie działowej) powinna posiadać miejsce umożliwiające umieszczenie torby/ plecaka ratunkowego z wyposażeniem? Jeśli tak, prosimy o podanie wagi wykorzystywanych przez Zamawiającego, wyposażonych plecaków ratunkowych. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w zakresie norm dźwigania dla kobiet, Zamawiający wymaga przygotowania miejsca i systemu mocowania plecaka o minimalnej masie 12 kg, mocowanego standardowo tj. u dołu szafki na ścianie działowej.

Zamawiający wymaga aby szafka z szufladami, zamontowana w przedziale medycznym (na ścianie działowej) posiadała miejsce umożliwiające umieszczenie torby/ plecaka ratunkowego z wyposażeniem o masie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w zakresie norm dźwigania.

Pytanie 2

Dot. pkt. 88 załącznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga zaoferowania szafki z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z co najmniej trzema szufladami. Prosimy o informację jakiego rodzaju wyposażenie będzie transportowane w w/w szufladach.

Drobny sprzęt medyczny, leki, opatrunki lub drukarka.

Pytanie 3

Zgodnie z punktem 100 załącznika nr 1 do SIWZ o treści „Wszystkie oferowane rozwiązania są elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu. Załączyć do oferty protokół z badań dynamicznych oraz schematy oferowanej zabudowy potwierdzone przez jednostkę badawczą”, chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku załączenia do oferty potwierdzenia wykonania testów wytrzymałościowych zabudowy całkowicie innej niż oferowana, na innym pojeździe bazowym niż oferowany?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty schematu oferowanej zabudowy medycznej, która została poddana testom wytrzymałościowym, schematu potwierdzo-

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

nego przez jednostkę badawczą, tj. jedyne dokumentu, który umożliwi Zamawiającemu podstawową weryfikację?

Nadmieniamy, że Zamawiający wymaga zgodności z normą PN EN 1789+A2, (takiej zgodności wymaga m.in. NFZ).

Jedną ze składowych takiej zgodności z w/w normą (tym samym składową homologacji całopojazdowej, a konkretnie dyrektywą 2007/46/WE), jest wykonany przez producenta ambulansu, test zderzeniowych tzw. test 10G, oferowanej marki i modelu ambulansu- konkretnej- oferowanej zabudowy medycznej. Oznacza to, że nie można oferować zabudowy innej czy też trochę podobnej do tej, która była przedmiotem badań wytrzymałościowych lub zabudowy przebadanej na innej marce i modelu aniżeli oferowana Zamawiającemu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy urządzenia do dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby prędkość wyrzutu z dyszy wynosiła 80m/s?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy urządzenia do dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby szybkość turbiny wynosiła 22000 rpm?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy urządzenia do dezynfekcji. Czy Zamawiający dopuści czas ekspozycji do 2 godzin, czas ten jest niezbędny po dezynfekcji po skażeniu (podejrzenie dużego zanieczyszczenia mikrobiologicznego).

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy urządzenia do dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby środki dezynfekujące kompatybilne były produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 9

Dot. §5 ust. C Wzoru Umowy

Z uwagi na procedury obowiązujące w spółce, prosimy o zmniejszenie wysokości zaproponowanej kary umownej do 0,2% wartości umowy brutto , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zamawiający nie wyraża zgody, ale dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie §5 ust. 1 C, obniżający wysokość kary umownej do wysokości 0,5%.

Pytanie 10

Z uwagi na brak możliwości zaoferowania lodówki sprężarkowej ze względu na ograniczoną ładowność ambulansu o DMC3,5t prosimy o dopuszczenie lodówki pod zabudowę, znanego producenta Waeco model TBW203, o pojemności 2,5l i możliwości obniżenia temperatury o 20°C poniżej temperatury zewnętrznej.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie systemu sterowania odbiornikami, montowanego w przedziale medycznym, w którym jest możliwość sterowania światłami „roboczymi” z paneli montowanych przy drzwiach tylnych jak i panelu montowanego na szafce przy prawych drzwiach przesuwnych.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Z uwagi na szczególnie okres w jakim postępowanie zostało ogłoszone, prosimy umieszczenie we Wzorze Umowy zapisu o treści:

” Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę z pełną świadomością ogłoszonego na terenie RP w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzającego go stanu zagrożenia epidemiologicznego niemniej jednak postanawiają, że w razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego:

- a) odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy,
- b) w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy - odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę,
- c) w razie gdy w/w okoliczności doprowadzą do znaczącego zwiększenia kosztów produkcji, odpowiedniego zwiększenia ceny sprzedaży.

2. Strony ustalają, że zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 mogą być następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wskazując dodatkowo na fakt, iż sił wyższa uregulowana jest w kodeksie cywilnym oraz ustawach o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych Ustaw, w których przewiduje wiele korzystnych rozwiązań dla Wykonawców w zakresie realizacji umów o zamówienie publiczne.

Pytanie 13

Pytanie dotyczące noszy głównych karetkowych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności nosze M-1 firmy Stryker o możliwości płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni ? (pkt. 110)

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pytanie dotyczące transportera noszy głównych karetkowych:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych M-1 firmy Stryker spełniający zalecenia Normy PN-EN 1789:2007+A1:2010? (pkt. 127);

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁÓDZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Aktualnie obowiązujące zalecenia Normy PN-EN 1789:2007+A2:2014 w swojej treści dotyczącej mocowania noszy są tożsame z treścią Normy PN-EN 1789:2007+A1:2010. Punkt 5.4.2 Normy PN-EN 1789:2007+A2:2014 wskazuje, że podstawa noszy tzw. laweta do której jest przymocowane zapięcie noszy powinna być zgodna z EN 1865-5:2012, a urządzenie do mocowania noszy na podstawie powinno być sprawdzone poprzez odpowiednie badanie o wartości 10G bez wskazywania numeru Normy pkt. 4.5.9. Oferowany przez nas system transportowy (nosze, transporter, materac, pasy) wraz z zapięciem noszy spełnia ww. parametr opisany w pkt. 4.5.9.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 15

Pytanie dotyczące transportera noszy głównych karetkowych:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do zaoferowania rozwiązanie polegające na zastosowaniu siłownika rozpierającego (rozkładającego) golenie przednie noszy podczas ich wyprowadzania w Ambulansu? (pkt. 133) Proponowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla rozwiązań zabezpieczających wyjazd noszy z ambulansu przy nierozłożonym podwoziu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 16

Pytanie dotyczące transportera noszy głównych karetkowych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw transportowy (nosze główne + transporter noszy głównych + materac) o łącznej wadze spełniającej zalecenia Normy 1865-1, choć rozkład wagi poszczególnych elementów zestawu został inaczej rozłożony?

Nosze i materac są lżejsze od wymagań Zamawiającego, ponieważ ta część może być przenoszona przez personel. Transporter jest nieznacznie cięższy od wartości zalecanej w Normie tj. 35.05 kg, ponieważ z założenia nie jest dźwigany przez personel medyczny - porusza się na kołach. Oferowany transporter poza przytoczonym parametrem dot. wagi spełnia wszystkie zalecenia normy PN-EN: 1865-1:2010 oraz zharmonizowanej, 1789:2007 w tym załącznik A1:2010. Powyższe potwierdza aktualna deklaracja zgodności wystawiona przez niezależną jednostkę notyfikowaną, której treść w części dotyczącej noszy i transportera jest tożsama z normą zharmonizowaną, a waga noszy ukompletowanych (nosze + transporter noszy + materac) spełnia parametr zalecanej wagi maksymalnej ww. zestawu wg. zapisów obowiązującej normy PN EN 1865-1. Odpowiednie dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski w załączniku do przesłanych pytań. (pkt. 135.)

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 17

Pytanie dotyczące krzeselka transportowego kardiologicznego składanego:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzeselko transportowe kardiologiczne składane z kołami o średnicy 12 cm ? (pkt. 146.)

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 18

Pytanie do defibrylatora:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności dobrze znany w Polsce defibrylator Lifepak 15 o następujących parametrach:

a. Zakres energii dwufazowej 2 – 360 J, z funkcją kardiowersji



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

- b. Czas ładowania energii do 360J <10 sek. (do 200 J < 6 sek)
- c. Przenośny, transportowy, odporny na drgania i udary; waga defibrylatora gotowego do pracy poniżej 10 kg
- d. Regulacja parametrów defibrylacji i uruchamianie drukarki z łyżek twardych i panelu czołowego defibrylatora
- e. Opakowanie transportowe; spełnianie norm dotyczących medycznego sprzętu ratunkowego pracującego w ambulansach systemu ratownictwa
- f. Odporność na kurz i wodę IP 44
- g. Defibrylacja dorosłych i dzieci przez odpowiednie łyżki i elektrody
- h. Kompensacja zmian impedancji klatki piersiowej pacjenta
- i. Zasilanie defibrylatora z akumulatorów LiOn (brak efektu pamięci). Czas pracy > 6 godz. dla 2 akumulatorów
- j. Ładowanie akumulatorów w zewnętrznej ładowarce zasilanej z gniazd z 12 V DC= lub 230 V AC~
- k. Stymulacja zewnętrzna w zakresie częstości 40 -170 imp./ min. i prądu 0 -200 mA. Tryby : „na żądanie” i asynchroniczna
- l. pomiar ekg 3; 6 lub 12- o odprowadzeniowy z odpowiednimi kablami; zakres pomiaru tętna: 20 – 300 u./min.; analiza i interpretacja przebiegu z wydrukiem diagnozy oraz pomiar wysokości odcinka S-T na wszystkich odprowadzeniach ekg z wydrukiem i możliwością transmisji do systemu Lifenet powszechnie używanego w Łodzi i okolicach przez modem 4G (transmisje bezpłatne) lub bluetooth
- ł. Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET dla dorosłych i dzieci
- m. Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi w zakresie 15 – 255 mm Hg dla różnych grup wiekowych w trybie ręcznym i automatycznym
- n. Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym w zakresie 0 – 99 mm Hg i częstości 0 – 99 odd./min. dla różnych grup wiekowych
- o. Ekran kolorowy LCD o przekątnej 8,4 cala z wyświetlaniem 3 krzywych dynamicznych
- p. Pamięć wewnętrzna 360 min. ciągłego zapisu ekg i 1000 tzw. zdarzeń terapeutycznych
- r. Wzmocnienie sygnału ekg w zakresie 0,25 – 4 cm/mV na 8 poziomach
- s. Metronom wspomagający RKO z podziałem na dzieci i dorosłych oraz pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w części IV pkt 2 SIWZ oraz §2 ust. 6 poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku wystawienia Zamawiającemu faktury VAT już w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i doręczenia jej wraz z ambulansem. Prosimy o zgodę na wystawienie faktury pierwszego dnia po wystawieniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o modyfikację Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ poprzez wyszczególnienie nazw konkretnych pozycji które Wykonawcy mają obowiązek w nim wycenić (kolumna pierwsza tabeli). Pozostawienie formularza w pierwotnej postaci, niesie ryzyko, że Wykonawcy mogą wskazać w pozycjach dowolnie wybrane przez siebie elementy, które mogą różnić się od siebie. Spowodować to może nieporównywalność ofert.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3, który jest załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” w ramach parametru opisanego w poz. 99 Załącznika 1 do SIWZ dodatkowo punktowane będą darmowe przeglądy okresowe zabudowy sanitarnej wraz z gwarantowanym ambulansem zastępczym o min. takich samych parametrach, natomiast zaoferowanie dwóch darmowych przeglądów okresowych zabudowy sanitarnej bez zagwarantowanego ambulansu zastępczego jest dopuszczalne, tylko nie będzie się wiązać z dodatkową punktacją (Wykonawca otrzyma wówczas w tym kryterium 0 pkt.).

Zamawiający potwierdza, że wykonanie 2 przeglądów darmowych zabudowy sanitarnej nie wiąże się z dodatkową punktacją.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „gwarancji pełnej” Zamawiający rozumie objęcie gwarancją wszelkich usterek powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie usterki, które mogą wystąpić w toku użytkowania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn ich powstania, np. za usterki powstałe z winy Zamawiającego czy osób trzecich.

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „gwarancji pełnej” Zamawiający rozumie objęcie gwarancją wszelkich usterek powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

Pytanie 23

Czy zamawiający dopuści samochód bazowy bez funkcji sygnalizacji martwego pola widzenia? Pozwoli to w znacznym stopniu skrócić czas realizacji zamówienia. Opcja ta jest oferowana najczęściej w samochodach o DMC powyżej 3,88t, a Państwo wymagacie ambulans o DMC do 3,5t.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Czy w ramach przeglądów okresowych Wykonawca ma obowiązek wycenić również koszty wymiany materiałów zużywalnych takich jak olej, klocki itd.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 25

Prosimy o wskazanie średniego rocznego ambulansu w km.

Średni przebieg ambulansu w przedziale 16-20 tys. km. rocznie.

Pytanie 26

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę § 4 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu treści: „Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 27

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonych w §5 ust. 1a) i d) projektu umowy z 10 % na 5 %,
- określonej w §5 ust. 1 b) projektu umowy z 1 % na 0,5%, - określonej w §5 ust. 1 c) projektu umowy z 2 % na 0,5%.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany dotyczące zapisu w §5 ust. 1 b, 1 c i 1 d. , Zamawiający dokonuje w tym zakresie modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 ust. 1a).

Pytanie 28

Proszę o zmianę §5 ust. 1 lit. a i c wzoru umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień zwłoki, a nie za opóźnienia. Utrzymanie zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar. Nadmienić należy że nowa ustawa p.z.p., która wejdzie w życie w styczniu 2021 r. zalicza postanowienie naliczania kar umownych za opóźnienie do niedozwolonych klauzul umownych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 29

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w §5 ust. 3 istotnych postanowień umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do projektu umowy w §5 ust. 4 o następującej treści „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”.

Pytanie 30

Proszę o wykreślenie §5ust. 1 lit. d)wzoru umowy. Sankcja w postaci naliczenia tak wysokiej kary umownej jest naszym zdaniem nieproporcjonalna do naruszonego obowiązku, czyli niedostarczenia dokumentów wymienionych w §2ust. 6.

Zamawiający zmniejszył wysokość kar w §5 ust. 1 d) zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 27.

Pytanie 31

Proszę o wykreślenie §6 zd. 1 wzoru umowy. Konieczność wprowadzenia niektórych zmian do umowy, choć niekorzystnych dla Zamawiającego, może być spowodowana okolicznościami w pełni niezależnymi od woli Wykonawcy. Takie zmiany do umowy powinny być możliwe do przepracowania.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 32

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna”

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 33

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o uwzględnienie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający poprzez zamianę §6 wzoru umowy na następującej:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- g) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
- h) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 34

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

drugą stroną, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w formie tradycyjnej i przesłanie umowy pocztą.

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Pytanie nie będzie miało zastosowania.

Pytanie 36

Prosimy o informację, dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana umowa w formie elektronicznej. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Pytanie nie będzie miało zastosowania.

Pytanie 37

Prosimy o usunięcie §6 zd. 2 i §10 wzoru umowy i dodanie w jego miejsce do treści umowy § Zawiadomienia oraz Postanowienia końcowe, o treści jak poniżej:

§ ____

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:
 - 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
 - 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

- 1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ ____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:
cy _____, Wykonawca: _____;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarcia niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.
6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.
7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 38

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§___

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

- a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
- b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
- c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
- d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
- e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁÓDZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wskazując dodatkowo na fakt, iż sił wyższa uregulowana jest w kodeksie cywilnym oraz ustawach o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych Ustaw, w których przewiduje wiele korzystnych rozwiązań dla Wykonawców w zakresie realizacji umów o zamówienie publiczne.

Pytanie 39

Prosimy o zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 98, 122, 140, 231 i 303 i dopuszczenie możliwości dokonywania napraw w autoryzowanym serwisie producenta zabudowy medycznej lub wyposażenia w sytuacji, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa. Niektóre z napraw mogą wymagać specjalistycznego sprzętu lub dokonania specjalistycznych czynności, których dostępność w siedzibie Zamawiającego jest ograniczona lub wręcz niemożliwa do osiągnięcia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 40

Proszę o potwierdzenie, że przez serwis pogwarancyjny, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 121, 139, 159, 177, 230, 267, 282, 302, 334 Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 41

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 42

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.


Pytanie 43

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, postańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁÓDZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 44

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 45

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną formę dostawy.

Pytanie 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do swojej siedziby.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z systemem wspomagania nagłego hamowania bez przerwania trybu działania świateł STOP, co w sytuacji pracy ambulansu nie ma znaczenia, a znacznie podnosi koszt pojazdu?

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuszcza, aby do oferty dołączyć dokument nadrzędny tj. Certyfikat Niezależnej Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z normą PN EN 1789+A2:2015 zamiast dokumentów cząstkowych i podrzędnych, jak np. Sprawozdanie z badań, z schemat zabudowy itp. ?

Wyjaśniamy, że kierując się troską o ekologię i ochronę lasów z korzyścią dla wszystkich jest załączenie dokumentu jednostronicowego jakim jest Certyfikat Zgodności wystawiony przez Niezależną Jednostkę

Notyfikującą, niż pliku dokumentacji liczącej 40-50 stron.

Należy zauważyć, że w przypadku wątpliwości zawsze można wykonawcę poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne w sytuacji zagrożenia.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 50

Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z podgrzewanymi lusterkami zewnętrznymi, stąd chcemy zapytać, czy dwa fotele w kabinie kierowcy winny posiadać podobną funkcjonalność tj. posiadać funkcję podgrzewania ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie zwiększa komfort i bezpieczeństwo dla zespołu ambulansu, a w/w rozwiązanie jest dostępne u każdego producenta samochodów, co nie stanowi dla nikogo wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Zamawiający opisał system serwisowania stosowany przez jednego producenta, stąd chcemy zapytać, czy dopuszcza się system sterowany po przez komputer pokładowy informujący z dużym wyprzedzeniem kierowcę o konieczności wykonania przeglądu serwisowego ?

Jest to rozwiązanie bardziej przyjazne dla kierowcy niepotrzebnie nie rozprasza go, gdyż komunikat o konieczności wykonania przeglądu wyświetla się w wymaganym momencie, odpowiednio wcześniej i nie „stresuje” kierowcy ciągłym obliczeniem, „ile mam jeszcze kilometrów do przeglądu” itp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha? Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Zamawiający nie wymaga.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 53

Prosimy w trosce o ekologię, aby do oferty zamiast homologacji pojazdu kompletnego oraz pojazdu skompletowanego (które liczą wiele stron) wykonawca mógł dołączyć tylko świadectwo zgodności pojazdu skompletowanego WE (bez załączników), które to dokumenty stanowią wyczerpującą informację o oferowanym ambulansie ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 54

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 55

Czy Zamawiający wymaga standardowej długości gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Wyjaśniamy, że obecne zapisy są ze szkodą dla Zamawiającego np. gwarancję na powłoki lakiernicze 36 miesięcy oferują wszyscy producenci nowoczesnych samochodów na świecie, a tylko producenci stosujący stare technologie lakiernicze oferują 24 miesiące gwarancji, podobnie jest gwarancją na perforację.

Zamawiający wymaga:

Gwarancja mechaniczna na pojazd min. 24 m-ce, bez limitu kilometrów.

Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu min. 24 m-cy.

Gwarancja na perforację nadwozia pojazdu min. 24 m-cy.

Gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) min. 24 m-ce.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z Aktywnym Systemem Wspomagania Nagłego Hamowania z przerywanym trybem działania świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Prosimy o potwierdzenie, że Asystent martwego punktu winien być fabrycznym rozwiązaniem producenta pojazdu bazowego ujętym w homologacji pojazdu kompletnego, a nie urządzeniem dokupionym na giełdzie i nieprzebadanym ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, że kolor nadwozia biały lub żółty (RAL 1016) winien być fabryczny tj. wykonany w fabryce producenta pojazdu bazowego i objęty pełną gwarancją na lakier ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 59

Opisane w załączniku nr 1 w punkcie 52 pomocnicze ogrzewania elektryczne jest stosowane wyłącznie w niemieckich samochodach marki Mercedes oraz Volkswagen, dlatego prosimy o dopuszczenie nagrzewnicy montowanej na etapie zabudowy o parametrach nie gorszych niż opisuje pkt 52, co rozszerzy krąg wykonawców z korzyścią dla Zamawiającego ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Prosimy o wyrażenie zgody, aby przy oferowanej długości przedziału medycznego mniejszej niż 3,2m fotel u wezłowania noszy był bez funkcji przesuwu ?

Wyjaśniamy, że w ambulansach posiadających przedział medyczny krótszy niż 3,2m funkcja przesuwu jest niewykorzystywana, a opcja ta niepotrzebnie znacząco podnosi cenę karetki.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Czy Zamawiający wymaga, aby „prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy” przez transporter noszy głównych umożliwiło prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach, co umożliwiają kółka jezdne skrętne o 360 stopni?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 62

Z uwagi na możliwe problemy z dostępnością do butli tlenowych opisanych w SIWZ chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butli tlenowej aluminiowej o pojemności 2,7 l i reduktorem ciśnienia z szybkozłączem typu AGA i przepływomierzem tlenowym regulowanym w zakresie 0-25l/min posiadającym manometr mechaniczny ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Dotyczy pkt. 183

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płachty ratowniczej o obciążeniu maksymalnym wynoszącym 250 kg ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Dotyczy pkt. 210 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora o wadze maksymalnej nie przekraczającej 2,8 kg ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy pkt. 220 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora transportowego posiadającego tryb wentylacji CPAP regulowany w zakresie do max. 20 cm H₂O ?

Zamawiający dopuszcza.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 66

Dotyczy pkt 226 SIWZ

Czy układy oddechowe pacjenta i układy oddechowe CPAP mają być wielorazowego użytku ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 67

Dotyczy pkt 228 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bulti tlenowej aluminiowej o pojemności 2,7 l i reduktorem ciśnienia z szybkozłączem typu AGA i przepływomierzem tlenowym regulowanym w zakresie 0-25l/min posiadającym manometr mechaniczny ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor/defibrylator ZOLL X Series / X Series Advanced z czasem ładowania do energii maksymalnej 200J w 7 sekund (punkt 238 SIWZ)?
Uzasadnienie: W monitorze defibrylatorze ZOLL X Series / X Series Advanced użytkownik ma do dyspozycji w standardzie rozwiązanie See Thru CPR (cyfrowy filtr EKG), które poprzez prezentację na ekranie w czasie bieżącym rytmu EKG pacjenta, odfiltrowanego od zakłóceń powstających przy uciskaniu klatki piersiowej, pozwala na wcześniejsze przygotowanie energii do defibrylacji, przez co czas ładowania nie ma wpływu na ewentualne przerwy w uciskaniu.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Czy Zamawiający poprzez wymaganie maksymalnej wagi urządzenia poniżej 10 kg. (pkt. 236 SIWZ) rozumie wagę kompletnego, gotowego do pracy urządzenia z akcesoriami: zaopatrzone wszystkie miejsca na akumulatory, z papierem w drukarce termicznej, z torbą na akcesoria z paskiem do przenoszenia na ramię, z łyżkami twardymi dla dorosłych i dzieci, modemem do transmisji, kablem do wykonania 12 odpr. EKG?

Uzasadnienie: Określenie maksymalnej wagi urządzenia z wyszczególnieniem akcesoriów lub funkcji jakie urządzenie gotowe do pracy ma dostarczać daje możliwość porównania rozwiązań oferowanych przez różnych producentów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 70

Czy Zamawiający określi minimalny stopień odporności na kurz i zalanie wodą zgodnie z powszechnie obowiązującą normą IP (PN-EN 60529) na poziomie IP55, co zabezpiecza urządzenie (przy użytkowaniu wszystkich opcji monitorowania pacjenta: EKG, SPO2, NIBP, EtCO2) przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony i chroni wnętrze przed dostępem do części niebezpiecznych przed pyłem?

Uzasadnienie: Zabezpieczenie urządzenia przed narażeniem na czynniki zewnętrzne zapewnia możliwość użytkowania sprzętu w różnych niesprzyjających warunkach z jakimi spotykają się Zespoły Ratownictwa Medycznego. Określenie poziomu ochrony na niższym poziomie powodowałoby brak zabezpieczenia wnętrza przed ciałami stałymi mniejszymi od 1mm (cząstki widoczne gołym okiem, np. piasek), jak również możliwość uszkodzenia przez wodę polaną strumieniem (strumień wody np. z linii gaśniczej, węża ogrodowego).

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 71

Czy Zamawiający poprzez określenie wymagania w pkt 241 SIWZ dostarczenia łyżek twardech dla dorosłych i dzieci w komplecie, zainstalowane na defibrylatorze, wymaga aby łyżki twarde dla dzieci stanowiły komplet z łyżkami twardymi dla dorosłych w postaci jednego zestawu, zainstalowanego na defibrylatorze, w którym łyżki dla dzieci są stale dostępne dla personelu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów, nakładek, reduktorów?

Uzasadnienie: Łyżki twarde z opcją pediatryczną w postaci jednego zestawu, w którym łyżki dla dzieci są stale dostępne dla personelu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów, nakładek, reduktorów, dają 100% pewność możliwości przeprowadzenia elektroterapii, sprawdzenia stanu każdego pacjenta. Wszelkiego typu dodatkowe akcesoria, nakładki, reduktory powodują wydłużenie czasu przygotowania do rozpoczęcia badania pacjenta i ew. opóźnienie elektroterapii. W przypadku stosowania akcesoriów niezainstalowanych w zestawie z defibrylatorem może dojść do sytuacji w której potrzebne akcesoria nie będą zabrane, a nawet do zgubienia takich dodatkowych akcesoriów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 72

Czy Zamawiający poprzez określenie wymagania w pkt 241 SIWZ dostarczenia łyżek twardech dla dorosłych i dzieci w komplecie, zainstalowane na defibrylatorze, dopuszcza urządzenie w którym łyżki twarde (z dostępną opcją pediatryczną bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów) są przymocowane nie do obudowy defibrylatora, ale do specjalnie zaprojektowanych uchwytów w torbie transportowej, która to torba stanowi standardowe wyposażenie defibrylatorów ZOLL X Series / X Series Advanced (zdjęcie poglądowe poniżej).



Uzasadnienie: Prezentowany zestaw zapewnia stały dostęp do łyżek twardech, jest rozwiązaniem stosowanym przez producenta na całym świecie. Jednocześnie poprzez swoją konstrukcję (kabel terapeutyczny odczepiany od łyżek twardech) nie ma konieczności stosowania oddzielnych kabli terapeutycznych do podłączenia elektrod miękkich do elektroterapii (koniecznych do stosowania stymulacji przezskórnej) – elektrody przyłącza się do tego samego złącza, co łyżki twarde. Daje to wygodę w użytkowaniu zestawu, przy testowaniu codziennym testowany jest również kabel terapeutyczny.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kapnometru o parametrach przewyższających wymagane w SIWZ (pkt. 271-274 SIWZ) wbudowanego w defibrylator np. ZOLL X Series / X Series Advanced?



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Uzasadnienie: Używanie kapnometru jest związane z monitorowaniem pacjenta w stanie ciężkim. W takiej sytuacji wymagane jest również monitorowanie innych parametrów życiowych pacjenta, co wymaga użycia monitora/defibrylatora, a tym samym zapewniona jest stała dostępność kapnometru. Dodatkowo parametry pracy kapnometru wbudowanego w urządzenie ZOLL X Series / X Series Advanced przewyższają wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 74

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora fabrycznie nowego, nieużywanego z rokiem produkcji 2019?

Uzasadnienie: Zaoferowanie sprzętu z zasobów magazynowych producenta z roku produkcji 2019 pozwala na skrócenie czasu dostawy, co w obecnej sytuacji zaburzenia łańcuchów dostaw na całym świecie przez pandemię SARS-CoV2 może powodować problemy w bieżących dostawach.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 75

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kapnometru i pulsoksymetru (opisanych w pkt. 268 – 282 SIWZ) jako oddzielnych urządzeń monitorujących przy zapewnieniu co najmniej takich samych parametrów monitorowania pacjenta?

Uzasadnienie: Oddzielne urządzenia są zdecydowanie bardziej poręczne, są lżejsze, często nie wymagają zewnętrznych źródeł zasilania, przy zapewnieniu co najmniej takich samych parametrów pomiarowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 76

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kapnometru i pulsoksymetru również z roku produkcji 2020 (pkt. 270 SIWZ)?

Uzasadnienie: Dostawa sprzętu z rokiem produkcji 2020 jest dostawą z bieżącej produkcji – nie wszyscy producenci posiadają zapasy magazynowe z 2019 r..

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora/defibrylatora z jednym akumulatorem (zapełnione wszystkie gniazda akumulatorów przewidziane przez producenta)? Dotyczy pkt. 256 SIWZ

Uzasadnienie: Urządzenia różnych producentów różnią się od siebie w kwestii szczegółów projektu zasilania przy zachowaniu możliwości doładowania urządzenia z 230V i 12V. W przypadku konieczności zaoferowania dodatkowego akumulatora do kompletnego zestawu urządzenia z akcesoriami (zapełnione wszystkie fabryczne gniazda akumulatorowe) podnosi to cenę zestawu. Zestaw: monitor/defibrylator ZOLL X Series/ X Series Advanced z jednym akumulatorem, zapewnia znacznie wyższe parametry pracy niż opisane przez Zamawiającego w SIWZ, tj. 7 godzin monitorowania EKG, 300 defibrylacji pełną energią.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora z zapewnionym przesyłaniem danych



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

do zewnętrznych urządzeń z wykorzystaniem standardów WiFi i Bluetooth bez konieczności dostawy modemu GSM?

Uzasadnienie: Dostępność transmisji WiFi i Bluetooth zapewnia szeroką możliwość korzystania z różnych zewnętrznych urządzeń do transmisji danych GSM. Zapewnia to możliwość nieograniczonej zmiany urządzenia przesyłającego np. w przypadku wprowadzenia nowych (szybszych) standardów transmisji danych w sieci GSM i wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, bez generowania dodatkowych kosztów stałych (abonament GSM do modemu).

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 79

Czy Zamawiający wymaga, aby producent defibrylatora (pkt 232-267 w SIWZ) przewidywał możliwość zastosowania/użycia wszystkich wymaganych funkcji monitorowania (12 odpr. EKG, SpO₂, NIBP, EtCO₂) i elektroterapii (defibrylacja tryb ręczny, AED, kardiowersja, stymulacja) u wszystkich grup wiekowych pacjentów – od noworodka (1 dzień) do dorosłego (bez ograniczenia wieku)?

Uzasadnienie: Brak takiego wymagania, a tym samym możliwości dostawy urządzenia „DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY Z FUNKCJĄ TRANSMISJI DANYCH” w którym producent przewiduje ograniczenia w stosowaniu niektórych funkcji, co do określonych grup wiekowych pacjentów, może doprowadzić do błędnych decyzji medycznych pracowników ZRM, a tym samym może narazić na śmierć pacjenta lub trwałe uszczerbek na zdrowiu. Charakter pracy ZRM przewiduje konieczność udzielenia należytej pomocy każdej osobie – bez ograniczeń wiekowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 80

Dotyczy noszy głównych

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje, żeby dostarczone nosze wyposażone były w 4 kółka skrętne o 360°, o średnicy przynajmniej 160mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 81

Dotyczy krzeselka transportowego kardiologicznego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

- Tylne uchwyty regulowane na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesła
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwa do czyszczenia i odporna na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesła
- Waga bez akcesoriów ok 13 kg

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Dotyczy noszy podbierakowych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nasze podbierakowe europejskiego producenta, wykonane w całości z aluminium, bez możliwości wykonania diagnostyki obrazowej RTG, o wadze 10 kg spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 83

Dotyczy płachty ratowniczej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nasze płachtowe europejskiego producenta, wykonane z łatwowymywalnego i dezynfekowanego materiału Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy, dodatkowo wzmocnienia poprzeczne i podłużne, 14 uchwytów do przenoszenia, rozmiar 200 cm x 120 cm, udźwig 250 kg, waga do 2kg, bez zakładek zabezpieczających?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, oraz dopuszcza 250 kg.

Pytanie 84

Dotyczy płachty ratowniczej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nasze płachtowe europejskiego producenta, wykonane z łatwowymywalnego i dezynfekowanego materiału Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy, 8 uchwytów do przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta, rozmiar 200 cm x 80 cm, udźwig 150 kg, waga ok 1,5 kg, nasze są wykorzystywane w wielu pogotowiach w całej Polsce?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, oraz dopuszcza 250 kg.

Pytanie 85

Dotyczy deski ortopedycznej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną, która posiada 14 uchwytów do przenoszenia na obwodzie deski, deska spełnia pozostałe wymagania OPZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Dotyczy deska ortopedycznej pediatrycznej:




Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści deskę stabilizującą pediatryczną wykonaną z twardego materiału odpornego na pleśń i bakterie, łatwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków, nie pochłaniającego wydzielin i płynów, zmywalnego, wyposażoną w 10 uchwytów do przenoszenia, mocowania na noszach itp., pasy pajęczynowe kodowane kolorami, waga ok. 3,7 kg, szerokość 41 cm, długość 125 cm, obciążenie max 100 kg, z zestawem demontowalnych klocków do stabilizacji odcinka szyjnego, umożliwiająca diagnostykę RTG, wyposażona w pokrowiec?

Załączamy poglądowe zdjęcia proponowanego rozwiązania.

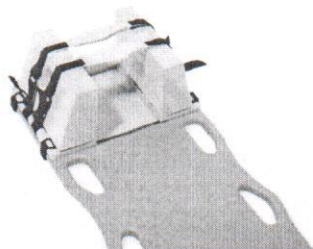

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Dotyczy respiratora transportowego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi parametrami:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3
- Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora
- Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek
- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg
- Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora
- Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV
- Tryb wentylacji wspomagananej SIMV
- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika
- Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta umożliwiający wentylację pacjenta w warunkach szpitalnych i ambulansowych
- Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji
- System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar
- Przepływ automatyczny do 70 l/min
- Zastawka PEEP dokręcana do zaworu pacjenta 0-20 cm H₂O
- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %
- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min
- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min.
- Waga respiratora ok. 1.1 kg
- Manometr manualny
- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie
- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu
- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy
- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min
- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami
- Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3; Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2
- Uchwyt ścienny zgodny z PN EN 1789
- Przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w rękę, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy, butla tlenowa aluminiowa 2,7l, reduktor typ Mediselect.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy Defibrylatora /monitora przenośnego z funkcją transmisji danych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów 5 sekund \pm 2 sekundy
- Pełne sterowanie za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych, drukowanie za pomocą dedykowanego przycisku na obudowie oraz każdorazowo automatycznie po wyładowaniu
- Czas pracy na 3 akumulatorach 600 min Monitorowania lub 428 defibrylacji energią 200J;



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

- 3 akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci, czas ładowania do 100% 2 godziny
- Ekran kolorowy TFT o przekątnej 8,4"
- Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odp. EKG,
- Wydruk interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych;
- Pamięć w postaci karty danych CF do zapisu monitorowania, defibrylacji, stymulacji, procedur terapeutycznych, danych pacjenta, zrzutów ekranu, dźwięków z otoczenia;
- Funkcja stymulacji zewnętrznej regulowana w zakresie 30-150 imp./min.
- Transmisja 12 odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem, transmisja GSM 3G z kartą SIM, bez kosztowa po stronie nadawcy i odbiorcy przez cały okres użytkowania defibrylatora transmisja pozwalająca na odbiór we wskazanych przez Zamawiającego miejscach wyposażonych w komputer z dostępem do internetu;
- 2 kable : 4 i 6 żyłowy do pomiaru 6 i 12 odprowadzeń EKG

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 89

Dotyczy kapnometru:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści funkcjonalnie równoważne rozwiązanie w którym pulsoksymetr i kapnometr stanowią osobne urządzenia i posiadają poniższe parametry:

Pulsoksymetr VM-2160 SMARTsat:

- Czujnik wielorazowy dla dorosłych i dzieci typu klips
- SpO2: 0 - 100%
- Częstotliwość pulsu: 20 - 300 1/min
- Dokładność SpO2%: +/- 2 (60 – 100% bez ruchu), +/-3 (70 – 100% w ruchu), +/- 2 (60 – 100% niska perfuzja, bez ruchu)
- Dokładność częstotliwość pulsu: +/-2 (bez ruchu)
- Wyświetlacz kolorowy 1.77" TFT, 65.000 kolorów, 128 x 160 pixeli
- Wyświetlane dane: SpO2, PR, pletyzmogram, trendy
- Wskaźnik jakości sygnału, amplitudy tętna, statusu baterii, wyciszenia alarmów, rozpoznanie czujnika, brak połączenia z czujnikiem
- Trend długotrwały poniżej 560 godzin
- Trend krótkotrwały (min) – 15/30/240
- Temperatura pracy: - 20°C + 50°C
- Temperatura przechowywania -30°C + 70°C
- IP 32
- Wymiary (DxSzxW) 11,8 cm x 6 cm x 2,5 cm

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

- Ciężar ok. 160 g (z bateriami, bez czujnika)
- Zasilanie 3 baterie (typu 1,5 Volt, Mignon AA)

Kapnograf Masimo model Emma:

- Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym
- Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta
- Waga ok. 60 g
- Pomiar stężenia CO2 w mmHg
- Zakres pomiaru CO2 : 0-99 mmHg
- Dokładność pomiaru CO2: +/- 2mmHg
- Pomiar częstotliwości oddechu w zakresie 3-150 oddechów
- Wizualne i akustyczne alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu ETCO2
- Wizualny i akustyczny alarm braku oddechu
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Wyświetlacz numeryczny LED dla ETCO2 i częstotliwości oddechów
- Zasilanie baterijne bateriami ogólnie dostępnymi w handlu, czas pracy 8-12h
- Temperatura pracy zgodnie z PN EN 1789 -5 °C
- Odporność na upadki – zgodnie z PN EN 1789

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności bezpłatną, nielimitowaną czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisję danych i 12 odprowadzeniowego zapisu EKG do szpitalnych systemów odbiorczych równoważnych z siecią LIFENET?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kapnograf z zakresem pomiaru częstości pulsu od 30 do 250 ppm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kapnograf o wadze 500g?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy parametru punktowanego (termin dostawy) – prosimy o zmianę punktowania terminu dostawy zamiast deklarowanych dat (sztywno), na dni od podpisania umowy np. 30,45,60 dni. Nie da się w takim krótki okresie od podpisania umowy wyprodukować ambulanżu, a do tego dochodzi okres świąteczny. Z uwagi na możliwe protesty, uzupełnienia do podpisania umowy może dojść np. 10 stycznia, a pierwszy punktowany termin to 15 stycznia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 94

Dotyczy parametru punktowanego – kryterium techniczne – instalacja tlenowa – z rozeznania rynku wynika, iż w obecnej sytuacji epidemiologicznej dostawa butli tlenowych (nawet tych za zero punktów), może być nie wykonalna. Prosimy o możliwość wyłączenia ich z postępowania.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania butli zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytania 62 i 67.

Pytanie 95

Dotyczy parametru punktowanego – kryterium techniczne – instalacja tlenowa - z rozeznania rynku wynika, iż wymagane butle są tylko do dzierżawy, ale nie do kupienia. Prosimy o wyłączenie ich z postępowania.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania butli zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytania 62 i 67.

Pytanie 96

Dotyczy parametru punktowanego – kryterium techniczne – instalacja tlenowa – czy Zamawiający dopuści oraz uzna za spełnienie parametru punktowanego, gdy Wykonawca dostarczy butle tlenowe stalowe 10 l, z odkręcalnymi reduktorami elektronicznymi, które na panelu sterowania pokazują aktualną pojemność tlenu w butli.

Zamawiający dopuszcza, ale nie uzna za spełnienie parametru punktowanego.

Pytanie 97

Dotyczy parametru punktowanego – kryterium techniczne – przeglądy zabudowy sanitarnej – czy Zamawiający zrezygnuje z ambulansu zastępczego jeśli przeglądy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego? Przegląd trwa ok. 3-6 godzin i wynajem na ten czas ambulansu zastępczego jest bezcelowy, jak i również awykonalny bo nikt na tak krótki okres nie wynajmuje pojazdu, a przełożenie i uzbrojenie ambulansu w sprzęt będzie trwało dłużej niż przegląd.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie 98

Czy Zamawiający wymaga w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów eksploatacyjnych samochodu bazowego (np. wymiana oleju, klocków, itp.) i sprzętu medycznego przez autoryzowany serwis? Rozwiązanie to może podnieść znacząco cenę oferty.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 99

Dotyczy OPZ pkt. 34 – prosimy o dopuszczenie akumulatorów kwasowych, montowanych na etapie produkcji samochodów bazowych i objętych ich gwarancją. Wymiana na akumulator kwasowy zwiększa koszt oferty.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 100

Dotyczy OPZ pkt. 50 – prosimy o dopuszczenie aby miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla dzieci i szyn kramera, był przedział medyczny – specjalnie przygotowane przestrzenie.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Dotyczy OPZ. Pkt. 52 – prosimy o rezygnację z tego parametru co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców, lub dopuszczenie w to miejsce niezależnego ogrzewania wodnego do wspomagania ogrzewania kabiny kierowcy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w powiązaniu z odpowiedzią na pytanie 59.

Pytanie 102

Dotyczy OPZ. Pkt. 65 – prosimy o dopuszczenie montażu głośników za grillem co nie wpływa na słyszalność, a ułatwia ewentualny serwis i konserwację, chroni mocniej przez warunkami atmosferycznymi.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103

Dotyczy OPZ. Pkt. 73 – czy dostarczone radiotelefony mają być zaprogramowane? Jeśli tak to czy Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy częstotliwości?

Radiotelefony nie muszą być zaprogramowane.

Pytanie 104

Dotyczy OPZ. Pkt. 73 – czy w kabinie kierowcy ma być zamontowana stacja dokująca dla radiotelefonu ręcznego, a druga dostarczona luzem?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 105

Dotyczy OPZ. Pkt. 76 – czy Zamawiający dopuści fabryczną antenę radiową samochodu bazowego (FM) dla radioodtwarzacza?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Dotyczy OPZ. Pkt. 80 – prosimy o dopuszczenie tylko dwóch lamp nad noszami które wystarczają do oświetlenia ewentualnego pola pacjenta.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 107

Dotyczy OPZ. Pkt. 86 – prosimy o dopuszczenie fotela bez przesuwu – jeśli długość przedziału medycznego nie przekracza 320 cm. W tym przypadku nie ma sensu montować przesuwu z uwagi na jego krótki zasięg.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108

Dotyczy OPZ. Pkt. 86 – czy przesuw fotela u wezglowia ma odbywać się w każdym momencie bez użycia narzędzi, np. analogicznie jak w fotelu kierowcy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 109

Dotyczy OPZ. Pkt. 95 – prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli poprzez oświetlenie ostrzegawcze? Czy np. dostawa jedna sztuki takiej lampy będzie uważane za spełnienie warunku?

https://sklepdrogowy.pl/lampy-i-sygnalizatory-drogowe/lampa-drogowa-dzienna-led-starflash-2000-dwustronna-u-35a?gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs721rAhA4-W6wA08B1PG6w6hzUDbX2qBXogI-SMsuBVg_SXm2g-SN44aAjSmEALw_wcB

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

Dotyczy OPZ. Pkt. 95 – czy Zamawiający uzna za spełnienie sterowania oświetleniem roboczym jeśli panele sterujące będą przy drzwiach tylnych oraz szafce ściany działowej?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Dotyczy OPZ. Pkt. 98 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o dni robocze z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 112

Dotyczy OPZ. Pkt. 104 – z uwagi iż rejestrator jest montowany w kabinie kierowcy, prosimy o rezygnację z tego wymogu gdyż nie jest on narażony na wodę oraz pył.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 113

Zamawiający nie wymaga pompy infuzyjnej – czy Wykonawca ma przygotować na jednym z adapterów tzw. uchwyt kątowy pod ewentualną pompę?

Zamawiający potwierdza wykonanie dodatkowego uchwytu na pompę infuzyjną.

Pytanie 114

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane ambulanse oprócz niezależnego od pracy silnika ogrzewania przedziału medycznego wyposażone były w ZALEŻNE od pracy silnika ogrzewanie wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik do BEZKOSZTOWEGO ogrzewania przedziału medycznego w trakcie uruchomionego silnika?

Wyjaśnienie:

Pozostawienie dotychczasowych wymogów bez zmian oznaczać będzie iż Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty zużycia paliwa przy ogrzewaniu przedziału medycznego, ze względu na fakt iż nawet przy umiarkowanych temperaturach do ogrzewania przedziału medycznego konieczne będzie załączanie niezależnego ogrzewania pobierającego paliwo konieczne do jego działania.

W przypadku zastosowania w przedziale medycznym dodatkowej nagrzewnicy w przedziale medycznym wykorzystującej ciecz chłodzącą silnik Zamawiający może ogrzewać przedział medyczny bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 115

Czy jeżeli pojazd bazowy posiada fabryczne akumulatory głębokiego rozładowania typu AGM to wymagana jest ich wymiana na akumulatory żelowe? Jeżeli TAK to czy dotyczy to wyłącznie akumulatora dodatkowego (dla przedziału medycznego) czy też zarówno akumulatora bazowego jak i dodatkowego?

Wyjaśnienie:

Pragniemy poinformować że wymiana fabrycznych akumulatorów na inne w okresie gwarancji może spowodować perturbacje z gwarantem pojazdu bazowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 116

Czy nie doszło do pomyłki przy określaniu wymogów względem uchwytów do systemu SWD PRM tzn. tabletu i drukarki tj. konieczności dołączania do oferty dokumentów dotyczących kabiny kierowcy zamiast przedziału medycznego? Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia wykonania badań dynamicznych uchwytu drukarki montowanego w przedziale medycznym zamiast uchwytu stacji dokującej tabletu z kabiny kierowcy?

Wyjaśnienie.

Badania dynamiczne zgodnie z normą PN-EN 1789+A2 wykonuje się dla PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO, a nie dla kabiny kierowcy.


Zamawiający dopuszcza zamontowania uchwytu do tabletu w kabinie kierowcy bez wymagania badań dynamicznych uchwytu.

Pytanie 117

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 85 Zamawiający wymaga "Na prawej ścianie min. jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietniki, (co najmniej z lewej strony) i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia)" bez dodatkowych opcji tj. podgrzewane siedzisko, podłokietnik czy przesuw.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WERM w Łodzi

dr. n. ekon. Witold Olszewski

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŁODZI



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188