



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.04.2024 r.

DZP – 5/2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 16, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przetwornika o długości linii 152 cm (122+30). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 16, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie z jakimi dokładnie monitorami ma być kompatybilny wymagany kabel.

**Odp.** Zamawiający wymaga kabli do monitorów: GE Medical, Philips, Walmed typ Comen, Mindray typ BeneVision, Draeger.

### **Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 16, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby przetworniki w pozycji 1 i 2 były wyposażone w koreczki w kolorze kontrastowo żółtym, w celu uniknięcia kontaminacji, oraz dodatkowe naklejki identyfikujące/ kodujące linie? Takie rozwiązanie przyczyni się do ułatwienia pracy i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 16, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do pomiaru ciśnienia wyposażonej w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 12 cm<sup>3</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG piankowe, prostokątne 36x48 mm na żelu stałym, bezlateksowe, w op.= 50 szt. Zdjęcie poglądowe poniżej.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO




Województwo  
Śląskie



**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 20, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG włókninowe, okrągłe o śr. 36 mm, w op.= 50 szt. Zdjęcie poglądowe poniżej.

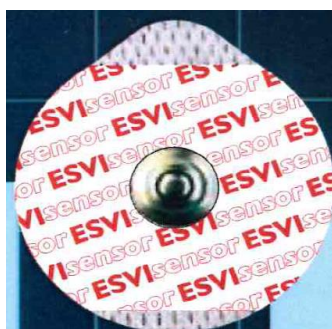

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku..

**Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach: przenośny, jałowy, apirogeny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z elastomeru silikonowego zamiast poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu w dystalnej części. Pompa o szerokim zakresie podaży od 215 do 335ml, objętości nominalnej 275ml, która poda z prędkością nominalną 5ml/h w czasie 48h i z prędkością 10ml/h w czasie 27h. Pompa posiada sztywną obudowę chroniącą leki przed promieniowaniem UV oraz selekcję zanieczyszczeń na przebiegu linii jednocześnie zapewniając podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu w mikrobiologicznie zamkniętym systemie . Pragniemy nadmienić, że oferowane przez nas pompy są biokompatybilne z powszechnie stosowanymi cytostatykami takimi jak 5-Fluorouracylem. Ponadto pragniemy zauważyć, że filtry cząsteczkowe na ostatnim odcinku zestawów do przetoczeń są powszechnie stosowane dla ochrony pacjenta przed infuzją ewentualnych krystalizatów leków, pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń pochodzących ze zbiorników infuzyjnych. W żaden sposób również nie naruszają systemu zamkniętego zapewniona jest pełna ochrona mikrobiologiczna podawanego leku. Filtry te jednocześnie są hydrofobowe zatem odporne na zwilżenie i nie stanowią ograniczenia dla czynności higienicznych pacjentów.

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy obudowa i dren mają chronić leki światłoczułe?

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 19, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Dufour wykonanego z 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 19, poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki Dufour posiadały atraumatyczne zaokrąglone zamknięte zakończenie umożliwiające użycie cewnika z mandrynem w razie konieczności, z dużym owalnym oczkiem drenażowym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 19, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje, aby zestaw umożliwiał manualny pomiar ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, tak jak w dotychczas stosowanych przez Zamawiającego zestawach, bez konieczności podłączenia do zewnętrznego monitora?

**Odp.** Tak.

**Pytanie nr 12 – dot. Pakiet nr 19, poz. 8**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby w celu umożliwienia dokładnego odczytu godzinowej diurezy komora pomiarowa posiadała skalę linearną, skalowaną co 1 ml. od 1 do 40 ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13 – dot. Pakiet nr 44**

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy uniwersalne wzmocnione z fartuchami wzmocnionymi. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

2 x przylepna serweta 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25 cm

1 x przylepna serweta 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody

1 x przylepna serweta 175x200 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody

1 x taśma lepna 9x50 cm

1 x uchwyt na przewody typu rzep 14x2,5 cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrością 20x30 cm

3 x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację wody – min. 170 cmH<sub>2</sub>O, poza obszarem krytycznym min. 45 cmH<sub>2</sub>O. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 17 cm, rozmiary: 1x L 120cm i 2x XL 140cm. Fartuch w rozmiarze L i zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszej warstwie opakowania na wierzchu (na serwecie na stół narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu).

Serwety okrywające pacjenta, wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o niskiej gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log<sub>10</sub>. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14 – dot. Pakiet nr 29, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15 – dot. Pakiet nr 29, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 – dot. Pakiet nr 29, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17 – dot. Pakiet nr 29, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawka do prób tuberkulinowych 1 ml z igłą 25G 0,5 x 16 mm , z dodatkowym trzpieniem w uszczelniaczu, który umożliwia podaż maksymalnej dawki leku bez straty.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych firmy Margomed z kolcem typu stożek umożliwiającym wygodne wklucie do pojemnika, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1, 2, 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 45, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu infuzyjnego do stosowania ze sprzętem medycznym o poniższych parametrach:

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyć, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, przezroczysty, membrana jednorodna, przezroczysta, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21 – dot. Pakiet nr 45, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu infuzyjnego do stosowania ze sprzętem medycznym o poniższych parametrach:

Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 6, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści dren kehr o wymiarach 80x5x5cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 6, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści dren redona z medycznego PCV?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 – dot. Pakiet nr 6, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowany w roz. CH20-CH40 z 6 otworami bocznymi oraz 1 centralnym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 6, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia z zatyczką o długości 50cm w rozmiarach CH 4,5,6,8,10?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 6, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści Sonda Sengstakena, trójdrożna, wykonana z PCV, pomarańczowa, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, podziałka do 5cm, balon żołądkowy lateksowy

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów. Rozmiary CH16, CH18, CH21 (długość 105cm - dla dorosłych), CH 14 (długość 65cm - dla dzieci)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

czy zamawiający dopuści Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.:

24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min;

22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;

20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min;

20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min;

18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min;

18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min;

17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min;

16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min;

14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min;

z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatraskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt?

**Odp.** Tak, pod warunkiem, że dostępna będzie także wersja bez portu bocznego. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 30, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.:

24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min;

22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;

20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min;

20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min;

18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min;

18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min;

17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min;

16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min;

14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min;

z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wklucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna . Opakowanie max 50szt?

**Odp.** Tak, pod warunkiem, że dostępna będzie także wersja bez portu bocznego. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 29 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4 i 5**

Czy dla bezpieczeństwa kaniula ma posiadać mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180 stopni?

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych jednorazowych łyżek do laryngoskopu, wykonana z wytrzymałego ABS, światłowodowa, kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3, dostępne w wersji Miller (rozmiar 0 - 75mm; 1 -100mm, 2 - 130mm) oraz Macintosh (rozmiar 1 - 95mm; 2 - 120mm; 3 - 140mm; 4 - 160mm). Sterylna, opakowanie folia/papier?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 31 – dot. Pakiet nr 9, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści Rurka intubacyjna – nosowa z mankietem niskociśnieniowym wyprofilowanym w kształcie walca, z przezroczystym łącznikiem, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpięścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy’ego. Skalowana co 1 cm, oznaczenie cyfrą co 2 cm. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOTU. Balonik kontrolny i dren do wypełnienia mankieta w kolorze kontrastującym, sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie papier – folia w kształcie półksiężyca zapewniającym utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. Rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32 – dot. Pakiet nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny, wkład harmonijkowy, obudowa przezroczysta wykonana z polipropylenu. Wydajność filtracji bakteryjnej/ wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW i TBC. Osobna warstwa wymiennika ciepła i wilgoci. Zakres objętości oddechowej 200 -1500 ml, przestrzeń martwa 54 ml, waga 40 g, port do kapnografu. Opory przepływu 2,7 cm H<sub>2</sub>O 60 l/min, współczynnik wilgotności bezwzględnej 34,2 mg H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub>: 500 ml. Powierzchnia filtracji > 500 cm<sup>2</sup>. Wydajność wymiany ciepła 33°C przy V<sub>t</sub>= 500 ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33 – dot. Pakiet nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny, sterylne, antywirusowy, bakteryjny, z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii zamykany zatyczką. Skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów minimum 99,99 %, wydajność nawilżania co najmniej 30 mg/1l H<sub>2</sub>O. Masa nie większa niż 30 g. Połączenia ISO 22 mm i 15 mm?

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34 – dot. Pakiet nr 21, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w czasie odsysania-sterylny, zakończenia różnoimienne, poj. 40ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35 – dot. Pakiet nr 1, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z zintegrowanym regulatorem przepływu z niebieską skalą?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36 – dot. Pakiet nr 1, poz. 12-13**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 37 – dot. Pakiet nr 1, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 38 – dot. Pakiet nr 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm i filtrem płynu 5 µm?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 39 – dot. Pakiet nr 1, poz. 16**

Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 40 – dot. Pakiet nr 1, poz. 19-21**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym identyfikatorem otwarty/zamknięty?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41 – dot. Pakiet nr 1, poz. 19-21**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny, którego obudowa jest wykonana z poliwęglanu ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 42 – dot. Pakiet nr 1, poz. 20-21**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o średnicy 3,2mm/4,1mm?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 43 – dot. Pakiet nr 1, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o pojemności wypełnienia 0,3ml?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 44 – dot. Pakiet nr 1, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o pojemności wypełnienia 1,0ml?

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie



**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 45 – dot. Pakiet nr 1, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o pojemności wypełnienia 1,8ml?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 46 – dot. Pakiet nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon typ płaski nie w formie harmonijki jak na załączonym zdjęciu o pojemności 200 ml zakończona uniwersalną końcówką?



**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47 – dot. Pakiet nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon z harmonijką o pojemności 300ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48 – dot. Pakiet nr 6, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z poliamidu?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 49 – dot. Pakiet nr 6, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe które można wielokrotnie sterylizować?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50 – dot. Pakiet nr 6, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe o śr. wew. 7mm, śr. Zew. 9,5mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 51 – dot. Pakiet nr 6, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dreny z tworzywa sztucznego balonowe bez możliwości sterylizacji?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 52 – dot. Pakiet nr 6, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 27, 30, 33,36 CH? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 53 – dot. Pakiet nr 6, poz. 10**

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia o długości 50 cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 54 – dot. Pakiet nr 6, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści sondy z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi o łagodnych krawędziach?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 55 – dot. Pakiet nr 6, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore o długości 85cm, z przewodnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 56 – dot. Pakiet nr 6, poz. 15**

Czy Zamawiający wymaga podłogowego ssaka do zbierania płynów w trakcie zabiegów wyposażonego w dren łączący i uchwyt?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57 – dot. Pakiet nr 6, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 58 – dot. Pakiet nr 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę CH12 z kontrolą siły ssania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 59 – dot. Pakiet nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem odpornym na zagięcia z wyprofilowanymi otworami drenującymi zapobiegające wrastaniu się tkanek i zatkaniu światła drenu?

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 60 – dot. Pakiet nr 7, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wysokociśnieniowego z drenem łączący 125cm i własnym, uniwersalny system podwieszenia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61 – dot. Pakiet nr 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności max. 0,9l?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 62 – dot. Pakiet nr 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 63 – dot. Pakiet nr 11, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19mm, o następującym budowie:



**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 64 – dot. Pakiet nr 11, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 65 – dot. Pakiet nr 17, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z końcówką Tiemann silikonowane z pojemnością balonu 5-10ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66 – dot. Pakiet nr 17, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire nieskalowane?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 67 – dot. Pakiet nr 17, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 68 – dot. Pakiet nr 17, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 69 – dot. Pakiet nr 21, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG włókninowa okrągła o średnicy 43mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70 – dot. Pakiet nr 21, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 71 – dot. Pakiet nr 21, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z łącznikiem typu T F/M, ustnikiem, rurką karbowaną i drenem jak na załączonym zdjęciu?



**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 72 – dot. Pakiet nr 21, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania o pojemności min. 25ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 73 – dot. Pakiet nr 21, poz. 13**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu z kontrolą siły ssania czy bez?

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 74 – dot. Pakiet nr 26, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 75 – dot. Pakiet nr 26, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 76 – dot. Pakiet nr 26, poz. 13**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylność), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odp.** Tak.

**Pytanie nr 77 – dot. Pakiet nr 26, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 78 – dot. Pakiet nr 26, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny wykonane z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim umożliwiającej obserwację wydzieliny, z szerokim wlotem worka zabezpieczony

polipropylenowym kołnierzem; obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią, brak zastawki; kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”, pojemność całkowita worka: 2000 ml, dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu, nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 79 – dot. Pakiet nr 29, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak. a’50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 80 – dot. Pakiet nr 29, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 81 – dot. Pakiet nr 29, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe 1ml z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm) w zestawie?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 82 – dot. Pakiet nr 29, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 83 – dot. Pakiet nr 30, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków do kaniul za opak. a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 84 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 85 – dot. Pakiet nr 30, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul bezpiecznych za opak. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 86 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w jednej wersji z portem iniekcyjnym, dostępne w następujących rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 87 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w wersji z portem iniekcyjnym w szerokiej rozmiarówce jak poniżej, oraz kaniule bez portu dostępne wyłącznie w 2 rozmiarach 26G i 24G?

**Kaniule z portem**

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Kaniule bez portu**

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 88 – dot. Pakiet nr 30, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w jednej wersji z portem iniekcyjnym, dostępne w następujących rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 89 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy posiadające elementy wykonane z medycznego PCV (komora kroplowa, dren, zatyczka filtra hydrofobowego) bez zawartości ftalanów (DEHP) ?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 90 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przyrządu o objętości wypełnienia drenu 17,92ml?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 91 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z ostrym kolcem ściętym ołówkowo 4-płaszczyznowo?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 92 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 93 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 94 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką identyfikującą rodzaj przyrządu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 95 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8  $\mu\text{m}$ ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 96 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1-2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 97 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką identyfikującą rodzaj przyrządu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 98 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem,

chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 99 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do transfuzji wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 100 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do przetaczania wyłącznie płynów infuzyjnych i leków światłoczułych, wolny od ftalanów?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 101 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z ostrym kolcem ściętym ołówkowo 4-płaszczyznowo?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 102 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy bursztynowe w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 103 – dot. Pakiet nr 42, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających 1 elastyczny ściągacz taliowy?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 104 – dot. Pakiet nr 42, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o szerokości 73-130cm?

**Odp.** Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

**Pytanie nr 105 – dot. Pakiet nr 42, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o szerokości 92-160cm?

**Odp.** Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

**Pytanie nr 106 – dot. Pakiet nr 42, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o szerokości 120-170cm?

**Odp.** Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

**Pytanie nr 107 – dot. Pakiet nr 42, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu ocznego w rozmiarze 5,5 x 7,5 cm, wykonanego z włókninowej części zewnętrznej, wewnętrzna część z pulpy celulozowej?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie



**Pytanie nr 108 – dot. Pakiet nr 42, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu ocznego w rozmiarze 5,5 x 7,5 cm, wykonanego z włókninowej części zewnętrznej, wewnętrzna część z włókniny bawełnianej i poliestru?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 109 – dot. Pakiet nr 42, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w rozmiarze 20x30cm?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 110 – dot. Pakiet nr 42, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w rozmiarze 15x20cm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 111 – dot. Pakiet nr 44, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z fartuchami o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x fartuch chirurgiczny standard, L


2 x fartuch chirurgiczny standard, XL

FARTUCHY: Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O.

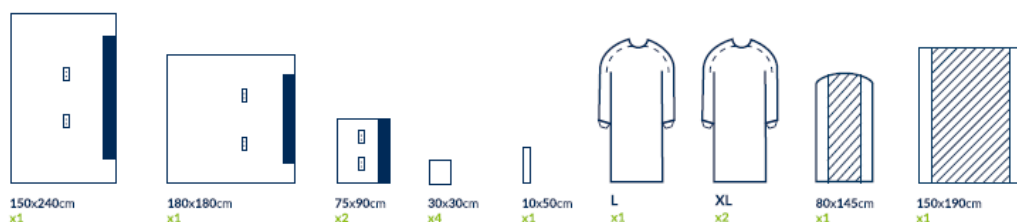

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 112 – dot. Pakiet nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający może podać ilości dla poszczególnych pozycji, gdyż są to dwa różne produkty:

1. Zestaw do podaży diety dojelitowej metodą grawitacyjną
2. Zestaw do podaży diety dojelitowej poprzez pompę.

Pozostałe zapisy bez zmian.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Odp.** Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 2 poz. 4, poprzez rozbić pozycji 4 na pozycję 4a i 4b:

4a. Zestaw do podaży diety dojelitowej metodą grawitacyjną – 3000 szt.

4b. Zestaw do podaży diety dojelitowej poprzez pompę – 500 szt.

W załączeniu przesyłamy zmodyfikowany Załącznik Nr 1A w zakresie pakietu 2 poz. 4.

**Pytanie nr 113 – dot. Pakiet nr 12, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego, poliuretanowy, z linią kontrastującą w promieniach Rtg tylko takie rozmiary CH 8 /120 cm, CH 10/120 cm, CH12/120 cm. Brak w asortymencie jednego producenta rozmiaru CH10/130 cm.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 114 – dot. Projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1 punkt 1.3 , 1.4 umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 115 – dot. Projektowanych postanowień umowy § 9 ust. 1 umowy**

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 116 – dot. Pakiet nr 29, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku..

**Pytanie nr 117 – dot. Pakiet nr 30, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 118 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,0-1,1/32-33mm oraz 25mm (20G) kolor różowy-przepływ 56ml/min, 1,2-1,3/40-45mm oraz 32mm (18G) kolor zielony-przepływ 90ml/min jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 119 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych firmy Margomed bezlateksowy, wolny od ftalanów, z komorą kroplową wolną od PVC, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany kłapką, z filtrem cząsteczkowym 15µm, dren o długości 150cm z zakończeniem Luer-Lock, kolec ścięty dwupłaszczyznowo w celu łatwiejszego wkłucia. Przyrząd wyposażony na zaciskaczu w pochewkę zabezpieczającą kolec po użyciu, opakowanie typu blister-pack jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 120 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi firmy Margomed bezlateksowy, wolny od ftalanów, z komorą kroplową wolną od PVC, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką, filtr do krwi 200µm, długość komory kroplowej min. 8cm, dren o długości 150cm z zakończeniem Luer-Lock. Przyrząd wyposażony na zaciskaczu w pochewkę zabezpieczającą kolec po użyciu, opakowanie typu blister-pack jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 121 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych oraz cytotoksycznych oprócz pochodnych taksanów firmy Margomed bezlateksowy, wolny od ftalanów, z komorą kroplową wolną od PVC, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką, z filtrem cząsteczkowym 15µm, dren o długości 150cm z zakończeniem Luer-Lock, kolec ścięty dwupłaszczyznowo w celu łatwiejszego wkłucia. Przyrząd wyposażony na zaciskaczu w pochewkę zabezpieczającą kolec po użyciu, opakowanie typu blister-pack jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 122 – dot. Pakiet nr 21, poz. 13**

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 25ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 123 – dot. Pakiet nr 26, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści tylko przezroczyste kieliszki?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 124 – dot. Pakiet nr 26, poz. 18**

Czy zamawiający dopuści worki na wymiociny z funkcją "Twist & lock" na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 125 – dot. Pakiet nr 26, poz. 20**

Czy zamawiający dopuści jałowy żel do USG w saszetkach o pojemności 20g?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 126 – dot. Pakiet nr 44**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego z fartuchami, o składzie i parametrach jak poniżej:

Wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>.

Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H<sub>2</sub>O.

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo, składana teleskopowo o wym. 80x145cm, wzmocnienie 60x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175x200cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75x90cm (wzmocnienie min. 45x60 cm)
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną wzmocniane nitką 30x40cm
- 2 fartuchy chirurgiczne niewzmocnione z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, rękaw typu raglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej. Zapinany na rzep - Velcro z tyłu i wiązany w pasie na dwie pary troków (wiązanie na czysto i na brudno). Zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania - rozmiar XL
- 1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, rękaw typu raglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej. Zapinany na rzep - Velcro z tyłu i wiązany w pasie na dwie pary troków (wiązanie na czysto i na brudno). Zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania - rozmiar L
- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm. Serweta wykonana z folii PE 50g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m<sup>2</sup>

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; zgodny z normą EN 13795-1.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 127 – dot. Pakiet nr 45 poz. 4**

W związku z odpowiedziami na pytania do ww. postępowania opublikowanymi dnia 28.03.2024 r. prosimy Zamawiającego o sprawdzenie, czy nie wkraść się błąd w odpowiedziach na pytania dotyczy pytania nr 19? „Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 45, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowy łącznik o przepływie 320ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*”

Odpowiedz sugerowałaby, że zamawiający oczekuje takiego samego produktu jak w odpowiedzi nr 16 „Pytanie nr 16 – dot. Pakiet nr 45, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego o przepływie 320ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający informuje, iż modyfikuje wyjaśnienia zamieszczone w dniu **28.03.2024r.**, w zakresie:

**- pytania nr 19 – dot. Pakiet nr 45, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowy łącznik o przepływie 320ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**- pytania nr 8 - dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkłuc żylnych o następujących przepływach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 38	105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje konieczność zaferowania kaniul w rozmiarach 18 G i 20 G o dwóch długościach / 25 mm i 32-33 mm dla kaniuli 20G oraz 32 i 40-45 mm dla kaniuli 18G/. Wyraża zgodę na

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

przepływy zaofertowane w pytaniu.

**- pytania nr 9 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkluc żylnych o następujących przepływach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45	100
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje konieczność zaofertowania kaniul w rozmiarach 18 G i 20 G o dwóch długościach / 25 mm i 32-33 mm dla kaniuli 20G oraz 32 i 40-45 mm dla kaniuli 18G/. Wyraża zgodę na przepływy zaofertowane w pytaniu.

Pozostała wyjaśnienia treści SWZ zamieszczone w dniu 28.03.2024 r. pozostają bez zmian.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż §3 projektowanych postanowień umownych zostaje dodany §3 ust. 20 o następującym brzmieniu:

*„20. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (dostawy częściowe), jednocześnie zastrzega sobie możliwość zmiany ilości między pozycjami w danym pakiecie w zależności od potrzeb, bez konieczności zmian w umowie, pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej wartości pakietu, o której mowa w § 5 ust. 3. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen jednostkowych na niezmiennym poziomie”.*

Pozostałe zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. Janusz Kuśmierz

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie