



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/14/19

Sucha Beskidzka, dnia 14.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (II)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy części nr 2 – stół operacyjny (załącznik nr 1b), wymagania podstawowe:


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z napędem elektrohydraulicznym, który jest bardzo często spotykany w stołach wysokiej klasy Producentów tego typu sprzętu? – dotyczy l.p. 1

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w konstrukcję podstawy i kolumny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat), która jest stabilna, trwała i łatwiejsza w dezynfekcji niż polerowana? – dotyczy l.p. 2, 3

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, pkt.3 parametr punktowany.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w podstawę w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stoppek. Długość podstawy 975 mm, szerokość 575 mm (szersza część), szerokość 425 mm (węższa część). Podstawa gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości 700mm – dotyczy l.p. 4, 5, 6

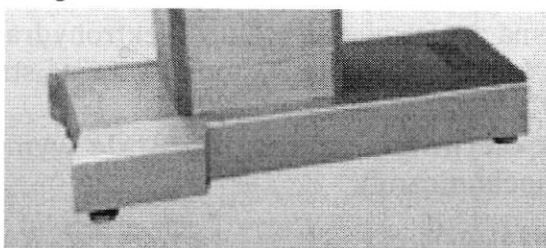

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym segmenty blatu wyposażone są w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG. Tunel w segmencie zagłówka, oparcia i siedziska. Szerokość 340mm – dotyczy l.p. 7

Odp. Zamawiający dopuszcza tunel w którym segmenty blatu wyposażone są w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG, tunel w segmencie zagłówka, oparcia i siedziska, pozostałe zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w blat (bez listew) o szerokości 500mm oraz blat (z listwami) o szerokości 560mm? – dotyczy l.p. 9

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w pilot bez wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania baterii. Pilot wyposażony również w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków. Pilot wykonany z materiałów wysokiej jakości, odporny na uszkodzenia, bez gumowej osłony – dotyczy l.p. 14, 17

Odp. Zgodnie z SIWZ, parametry punktowane.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym automatyczne rozłączanie następuje po upływie 30 sekund od ostatniego ruchu? – dotyczy l.p. 15

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie +75/-35 stopni? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 20

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany zakres, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ (stół elektromechaniczny).

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 665-1115mm (bez materaca)? Oferowany parametr w dolnej granicy różni się nieznacznie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu. Natomiast w górnym zakresie znacznie przewyższa oczekiwania Zamawiającego, co jest rozwiązaniem korzystnym i stwarzającym duże, dodatkowe możliwości w zakresie spectrum przeprowadzanych operacji – dotyczy l.p. 21

Odp. Zamawiający dopuszcza górny zakres 1115 mm, pozostałe (w tym stół elektromechaniczny) zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga +-40 stopni? – dotyczy l.p. 22 i 23

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany zakres, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ (stół elektromechaniczny).

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie 30stopni w każdą stronę? – dotyczy l.p. 25

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany zakres, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ (stół elektromechaniczny).

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją pozycji flex i reflex w zakresie 210/100 stopni? – dotyczy l.p. 26

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany zakres, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ (stół elektromechaniczny).

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym w zakresie 420mm? – dotyczy l.p. 27

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/-90stopni? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 30

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dźwigni regulacji manualnych (podgłówka, podnóżków) oznaczonych kolorem zielonym? Wymóg konkretnego koloru (żółtego czy czerwonego) nie ma uzasadnienia o charakterze klinicznym a stanowi jedynie ograniczenie konkurencji, co nie jest korzystne dla Zamawiającego - dotyczy l.p. 33

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o grubości 60 mm lub 80 mm, wykonanych tylko w kolorze czarnym? Wymóg wyboru kolorystyki nie ma uzasadnienia o charakterze klinicznym a stanowi jedynie ograniczenie konkurencji, co nie jest korzystne dla Zamawiającego – dotyczy l.p. 35

Odp. Zgodnie z SIWZ, parametr punktowany.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni? Prośbę swoją uzasadniamy okresem oczekiwania na podzespoły od naszych poddostawców oraz tym, że stoły operacyjne to wysokospecjalistyczny sprzęt, którego wykonanie wymaga odpowiedniej ilości czasu. Dodatkowo musi być on odpowiednio przetestowany i przechodzi wielostopniową kontrolę, zanim opuści halę produkcyjną.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem:

ZOB DYPLEK (ORA)
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

mgr Janusz Bączewski

