



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 17.05.2024 r.

DZP – 15/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych, bielizny, obłożeń jednorazowych oraz matryc z klejem do tkanek

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. projektowanych postanowień umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadzie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 w wysokości 0,5 % wartości netto umowy dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 16, jednak nie więcej niż 10% wartości netto umowy dla danego pakietu

1.7. naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 w wysokości 125 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

1.8. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 11 ust. 19) w wysokości 0,01% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto należnej kwoty. Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przyjmuje się okres 30 dni licząc od daty zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 17, poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z jedną taśmą samoprzylepną o wym. 10 x 50 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 18, poz. 3

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie 3 warstwowej łąty chłonnej wokół pola operacyjnego wykonanej z polietylenu i 2 warstw wiskozy. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 18, poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej, nieprzylepnej o wym. 150 x 180 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 18, poz. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stół narzędziowy o wym. 150 x 190 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 18, poz. 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie torby do zbiórki płynów gdzie w dolnej części znajduje się taśma samoprzylepna 5 cm, sztywnik oraz drobne sito i zawór. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 20, poz. 1, 2, 3 i 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.43g/m² zamiast sztywnego parametru 43g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 20, poz. 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do owinięcia zestawu wykonanej z laminatu o gramaturze 49g/m² zamiast 42g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 20, poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m² zamiast 60g/m², z warstwą wzmocnioną 73g/m² zamiast 62g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 26, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gąbkę czystą biologicznie, niejałową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 16 poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną dwuwarstwową?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 16 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną o gramaturze min. 60 g/m²?

Odp. Tak, pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 16 poz. 8 , 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 16 poz. 9

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 16 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35 x 120 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 16 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę materiał dwuwarstwowy (lamiant) chłonny na całej powierzchni + OP taśma 10 x 50cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 16 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści osłonę na rękaw a 1 sztuka?

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 16 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści chłonność min. 1000 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 16 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści podkład niejalousy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 16 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 28 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 16 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 220 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rzepem przy szyi pozostałe wiązanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu klasa palności fartucha nr 1 udokumentowana certyfikatem Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Żaden z załączników normy nie określa wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. "Palność" opisana w PN-EN 13795, zobowiązuje producentów obłożeń, fartuchów i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako "paliwo" podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in.

w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego klasy palności dla zaoferowanych fartuchów.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komplety w dwóch kolorach zielonym i niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tylko jeden kolor – niebieski?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny w rozmiarze 101 x 225 cm warstwa chłonna 50 x 200 cm?

Odp. Tak, pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny w zestawie dołączone jednorazowe, miękkie, chłonne, wykonane z włókniny bawełnopodobnej prześcieradło ochronne do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 102 x 152 (tolerancja +/- 2 cm).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy oznaczone literowo XXL w rozmiarze długość 155cm, szerokość 165 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu 2, poz. 10

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu 2, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu 2, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści tufpery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu 2, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści tufpery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu 2, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17n?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem w rozmiarze 6x7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowane patyczki oraz kompresy z wyceną osobno za patyczki oraz osobno za kompresy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu 4, poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu 4, poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka?

Odp. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu 4, poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe na nośniku z gazy bawełnianej 20 nitkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą bibułowo – foliową, zamiast włókninową foliowaną? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z opisem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 10x10cm z wkładem chłonnym 5x6cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 10x12cm z wkładem chłonnym 5x7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu 7, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za przyklepic o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu 7, poz. 24-25

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za przyklepic o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu 16, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu 16, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu 16, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z 3 warstwowego laminatu (włóknina + folia + włóknina)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu 16, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z 3 warstwowego laminatu (włóknina + folia + włóknina)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu 16, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wymiarach 35 x 120 cm z jedną taśmą lepną w komplecie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu 16, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego pięciowarstwowego chłonności 1177ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 54 – dot. Pakietu 16, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu niesterylnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu 16, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej na strzykawkę o wymiarach 21 x 30 cm?

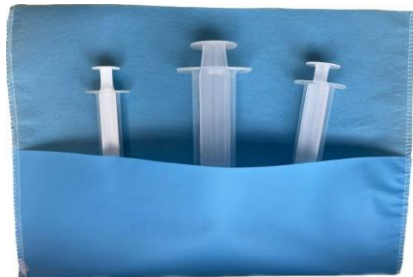

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu 16, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarach 30 x 60 cm, pakowanej a'1 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu 16, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 25g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 – dot. Pakietu 16, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 90 x 200 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu 16, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wyższej gramaturze niż wymagana?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do kraniotomii o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, ze wzmocnieniem 65 x 190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m², wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm


1 x serweta do kraniotomii dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego 60g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, włókninowe.

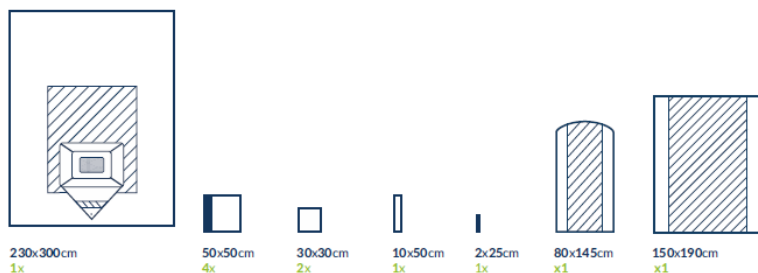

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu 17, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do artroskopii stawu kolanowego o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym i zaworem do podłączenia drenu

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O.

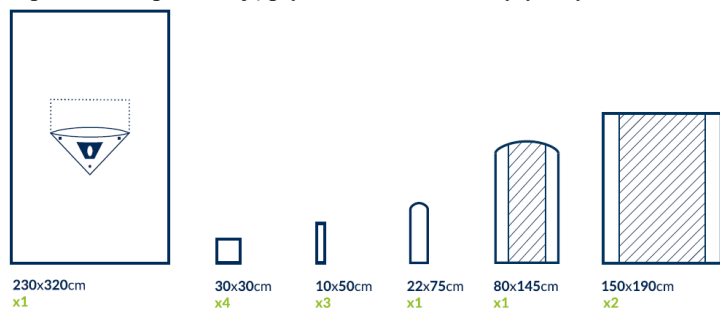

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu 17, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu urologicznego typu TUR o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm


1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 8 cm oraz kroczywym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora, lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości.

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma typu rzep 2x22cm

Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 287%.

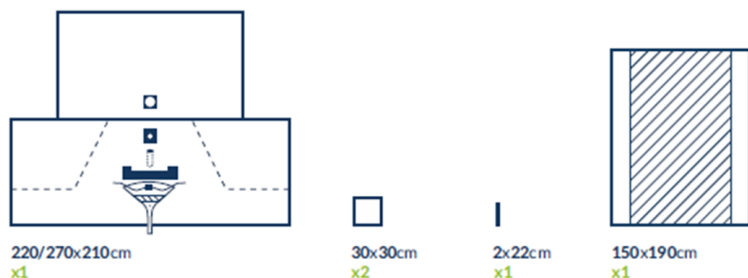

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63 – dot. Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą główną o wym. 225cm x 320cm z otworami udowymi o \varnothing 12cm wypełnionymi folią chirurgiczną, dookoła otworów warstwa wysoko chłonna o wym. 70cm x 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64 – dot. Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z podkładami chłonnymi pięciowarstwowymi z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej pokryte włókniną o wym. 60cm x 90cm o chłonności 1177ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65 – dot. Pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą główną z otworami udowymi oddalonymi od siebie o 30cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66 – dot. Pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z podkładami chłonnymi pięciowarstwowymi z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej pokryte włókniną o wym. 60cm x 90cm o chłonności 1177ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67 – dot. Pakietu 21, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem w polu krytycznym o odporności na przenikanie płynów 110cm H₂O przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68 – dot. Pakietu 21, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z podkładami chłonnymi pięciowarstwowymi z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej pokryte włókniną o wym. 60cm x 90cm o chłonności 1177ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69 – dot. Pakietu 21, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy oraz czy Zamawiający dopuszcza, aby miska znajdująca się w zestawie pełniła rolę blistra?

5 x Tupfer z gazy śr. 4cm (30cm x 30cm)

1 x Chwytnak plastikowy 23cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70 – dot. Pakietu 21, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 – dot. Pakietu 21, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogący służyć jako pojemnik na odpady bądź płyny powstałe podczas zabiegu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72 – dot. Pakietu 22, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73 – dot. Pakietu 22, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów z włókniny typu SMMS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 – dot. Pakietu 22, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów zapinanych w okolicy karku na standardowy rzep, z możliwością indywidualnego dopasowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 – dot. Pakietu 22, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletu chirurgicznego z włókniny o gramaturze 35g/m², przy szyi wykończenie typu V zakończone obszyciem w kolorze ubrania?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 – dot. Pakietu 22, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego dostępnego w kolorach zielonym i niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 – dot. Pakietu 23, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 – dot. Pakietu 23, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Miska z wewnętrznymi występami, 2500 ml

1 x Kubek-dzbanek poj. 500 ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 – dot. Pakietu 23, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Pojemnik okrągły poj. 1000ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Kubek-dzbanek poj. 500ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa?

Odp. W zakresie pozycji nr 3 - Zamawiający nie wyraża zgody, natomiast w zakresie pozycji 4 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 – dot. Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

CPL MATOSET ZESTAW DO DIALIZY 2XSM1 2PAK J	Serweta z laminatu FB	50x35	1
	Rękawice nitylowa bezpudrowe	M	2
START	Kompresy włókninowe 30 g/m2, 4W	7,5x7,5cm	6
	Cannula Plast	8x5,8cm	2
	Plastofix	2x15cm	4
	Rękawice nitylowa bezpudrowe	M	2
END	Rękawice nitylowa bezpudrowe	L	1
	Kompresy włókninowe 30 g/m2, 4W	7,5x7,5cm	4
	Fixopore S 5x7,2cm	5x7,2cm	2

Opakowanie Miękki blister.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 – dot. Pakietu 20 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zestawu do iniekcji doszkliskowych o składzie:

-1 serweta min.130x90 cm / laminat 2 w-wy 43g/m2/ ,

-1 serweta - obłożenie na pacjenta 90 x 75 cm / laminat 2 w-wy 43g/m2/ z otworem o średnicy 8 cm z folią klejącą naciętą poziomo i workiem odciekowym ,

-opatrunek gazowy na oko 8x6cm/ 5x6 cm,

-5 kompresów włókninowych 40 g 7,5x7,5 cm,

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- 1cyrkiel,
 - 1 patyczek watowy, 1
 - Korcanę plastikowy 13 cm,
 - 1 fartuch chirurgiczny rozm. M,
 - 2 ręczniki włókninowe.
 - 2 pojemniki plastikowe 60 ML
- Odp.** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 – dot. Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii zawierający:

1- serweta główna o wym. 220 x 320cm +/- 15 cm

uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 x 320 cm służącymi do zabezpieczenia pulpów sterowniczych. Serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej 56 g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O z 2 otworami z wejściem na tętnice udowe o \varnothing 9 cm +/- 1 cm , otoczone taśmą lepłą , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. min. 75 x 100 cm. Długość serwety liczona od otworów na tętnice udowe w kierunku głowy musi wynosić min. 60-65 cm, natomiast od otworów w kierunku stóp musi wynosić min. 225-230 cm. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tyłne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . Rozmiar L -125 , XL - 140 cm, 2 ręczniki celulozowe min. 50 x 40 cm, sterylny pokrowiec na ekran ochronny ściągany elastyczną gumką (połowa obwodu gumki 17 cm w stanie spoczynku, 71 cm po rozciągnięciu) x 91 cm - wysokość, pokrowiec na aparaturę RTG ściągany elastyczną gumką (połowa obwodu gumki 33 cm w stanie spoczynku, 112 cm po rozciągnięciu) o wysokości 56 cm, wykonane z folii PE o grubości min. 0,05 mm, miska poj. 500 ml plastikowa, miska poj.250 ml plastikowa, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 korcanę plastikowy 14 cm, 6 tupperów gazowych kula 50x50 cm, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m². Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 43 g/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 – dot. Pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii z 4 otworami zawierający:

1- serweta główna o wym. 240 x 370cm +/-15 cm uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 x 370 cm służącymi do zabezpieczenia pulpów sterowniczych. Serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej o gram 56 g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O z 2 otworami z wejściem na tętnice udowe o \varnothing 12 cm +/- 1cm , otoczone taśmą lepłą , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. 155 x 120 cm. Długość serwety liczona od otworów na tętnice udowe w kierunku głowy musi wynosić min. 60-65 cm, natomiast od otworów w kierunku stóp musi wynosić min. 225-230 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach tt. promieniowych o średnicy 7x12, otwory te powinny być otoczone taśmą lepłą, dookoła otworów warstwa wysokochłonna. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tyłne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . Rozmiar XL - 140 cm, 2 ręczniki celulozowe min. 50 x 40 cm, 1 sterylny pokrowiec na ekran ochronny ściągany elastyczną gumką 91x76 cm , 1 pokrowiec na aparaturę RTG ściągany elastyczną 80x40 cm , wykonane z folii PE o grubości min. 0,05 mm, 1 miska poj. 500 ml plastikowa z skalą, 1 miska poj.250 ml plastikowa ze skalą, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, 1 korcanę plastikowy 14 cm, 6 tupperów gazowych kula 50x50 cm, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm z włókniny 40 g . Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 43 g/m².

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 – dot. Pakietu 21, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii do wszczęcia rozrusznika zawierający:

1- serweta główna o wymiarach min 180 x 300cm z samoprzylepnymi dwoma otworami o średnicy 10 cm wypełnionymi folią chirurgiczną ,dookoła otworów warstwa wysokochłonna. Serweta wykonana z laminatu PP/PE o gramaturze min. 56 g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 250 cm H₂O. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tyłne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . Rozmiar L - 125 cm, 4 ręczniki celulozowe o wymiarach ok. 50 x 40 cm, 1 sterylny pokrowiec na ekran ochronny ściągany elastyczną gumką (połowa obwodu gumki 17 cm w stanie spoczynku , 71 cm po rozciągnięciu) x 91 cm - wysokość, miska poj. 500 ml plastikowa, miska poj.250 ml plastikowa, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 korcang plastikowy 14 cm, 6 tupferów gazowych kula 50x50 cm, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m². Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 43 g/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 – dot. Pakietu 21, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Pojemnik plastikowy, okrągły	125 ml	1
Tupfer włókninowy kula, 30g	20x20cm	5
Kleszczyki okienkowe typu KORCANG	19cm (+/-0,3)	1

Opakowanie typu blister z wgłębieniem na płyny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 – dot. Pakietu 21, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 125 ml i zapakowany w torebkę papierowo- foliową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 – dot. Pakietu 21, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

kleszcze plastikowe typu pean	13	1
Tupfer kula z włókniny 30g/m ²	20x20cm	6

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że w zestawie będzie pojemnik na płyny lub opakowanie typu blister z wgłębieniem na płyny.

Pytanie nr 88 – dot. Pakietu 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki ostro-ostre proste 11 cm +/- 0,3 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 – dot. Pakietu 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nożyczki w rozmiarze 15 cm +/- 0,3 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 – dot. Pakietu 25 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nożyczki w rozmiarze 14 cm +/- 0,3 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 – dot. Pakietu 25 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nożyczki w rozmiarze 17 cm \pm 0,3 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 – dot. Pakietu 25 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pęsetę w rozmiarze 12,5cm \pm 0,3 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 – dot. Pakietu 25 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści pęsetę w rozmiarze 15 cm \pm 0,3 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 – dot. Pakietu 25 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pęsetę w rozmiarze 14 cm \pm 0,3 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 – dot. Pakietu 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw chirurgiczny o składzie:

- 1 nożyczki chirurgiczne proste , ostro-tępe 14 cm \pm 0,3 cm, stalowe, jednorazowe,
- 1 pęseta chirurgiczna prosta 14 cm \pm 0,3 cm, jednorazowa , stalowa,
- 1 kleszczyki typu pean , zakrzywione 12,5 cm \pm 0,3 cm, jednorazowe , stalowe,
- 1 kleszczyki typu kocher proste 14 cm \pm 0,3 cm, jednorazowe , stalowe,
- 1 skalpel chirurgiczny nr 11,
- 1 serweta 2- warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm umieszczonym centralnie,
- 1 kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm, 5 szt.
- tufery z gazy 17nitkowe, 20 x 20 cm;
- 10 szt. kompresy gazowe 12 w-w, 17nitkowe 7,5 x 7,5 cm,
- 1 opatrunek chłonny samoprzylepny na ranę 15 x 8 cm.

Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy 90x150 cm. Narzędzia matowo wykończone zgodne z normą EN 980.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 – dot. projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.5. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy,

1.6. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy,

1.7. naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 w wysokości 150 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97 - dot. SWZ rozdz. X pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie folderów producenta lub importera na potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 98 - dot. Pakietu 17 poz. 1

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnie zestawu do operacji żyłaków o składzie i parametrach jak poniżej:

Wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 62 g/m² i chłonności 186 ml/m² wzmocnionego chłonną włókniną polipropylenową Spunlace o gramaturze 70 g/m² i chłonności min. 421 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo (folia PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m²)
- 1 serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 180/240 x 354 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 24x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach 100x75cm oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów z sztywnikiem
- 4 serweta samoprzylepna o wym. 45x45 cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny Spunlace 9x50cm
- 1 taśma typu „rzep” 2,5x25 cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm wyposażona w sztywnik
- 1 jednokomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm wyposażona w sztywnik
- 2 ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm
- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm (folia piaskowana PE 50g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m²)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normą EN 13795-1.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 - dot. Pakietu 17 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnie zestawu do artroskopii stawu kolanowego o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 62 g/m² i chłonności 186 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo (folia PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m²)
- 1 serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę ø7, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm
- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm (folia piaskowana PE 50g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m²)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normą EN 13795-1.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 - dot. Pakietu 17 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnie zestawu do zabiegów urologicznych o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 62 g/m² i chłonności 186 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Skład :

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200/260x185cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
 - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
 - 2 ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm
 - całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm (folia piaskowana PE 50g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m²)
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normą EN 13795-1.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101 - dot. Pakietu 22 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch zapinany standardowo na „rzep” na szyi (w miejsce taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha). Klasa palności 1 potwierdzona specyfikacją danych produktowych producenta. W opakowaniu 2 ręczniki 30 x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102 - dot. Pakietu 22 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletów chirurgicznych posiadających bluzę z wykończeniem w kształcie V pod szyją. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 - dot. Pakietu 17, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70 g/m² . Wielkość wzmocnienia min. 64 cm x 140 cm, w kształcie worka;

Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min 56g/m². Serweta posiada, w strefie krytycznej dodatkowy obszar wzmocnień 2-warstwowy (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze min 56g/m². Odporność na penetrację płynów min. 230 cm H₂O. Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny ze wzmocnieniem min. 190 ml/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104 - dot. Pakietu 17, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 150cm wzmocnienie min. 64 x 140 cm

Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 150 x 190 cm wzmocnienie min. 64 x 190 cm. Wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 56 g/m²., odporność na penetrację płynów min. 230 cm H₂O . Włóknina bez lateksu. Chłonność włókna badana min. 190 ml/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105 - dot. Pakietu 17, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie serwetki wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 106 - dot. Pakietu 18, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniiny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70g/m². Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, w kształcie worka. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniiny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107 - dot. Pakietu 18, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniiny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70g/m². Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, w kształcie worka. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniiny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 108 - dot. Pakietu 18, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie: Zestaw uniwersalny wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włókniina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 56 g/m². 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 150cm wzmocnienie min. 64 x 140 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109 - dot. Pakietu 18, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniiny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70g/m². Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, w kształcie worka. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniiny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110 - dot. Pakietu 18, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniiny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70g/m². Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, w kształcie worka. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniiny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 - dot. Pakietu 18, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniiny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70g/m². Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, w kształcie worka. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniiny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 - dot. Pakietu 18, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie: 1 x serweta na stół Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniiny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70g/m². Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, w kształcie worka. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniiny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113 - dot. Pakietu 18, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie: Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114 - dot. Pakietu 18, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie: 1 serweta na stolik Mayo 80 x 150cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 70 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115 - dot. Pakietu 18, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie: Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny smms długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wym. 10 x 50cm x 1 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 - dot. Pakietu 18, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie: Serweta jałowa z taśmą lepłą o wym. 150 x 240 cm wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) o gramaturze min. 56g/m². Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H₂O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 - dot. Pakietu 18, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie: Serweta jałowa o wym. 150 x 250 cm z wycięciem U o wym. 10x80 cm i taśmą lepłą wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 56g/m². Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H₂O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118 - dot. Pakietu 19, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie: Serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 150 cm, wzmocnienie 60 x 80 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 - dot. Pakietu 20, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie: Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m² plus dodatkowe wzmocnienie o gram 56 g/m²

1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H₂O

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120 - dot. Pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializy, spełniającego definicje MDR i ustawę o wyrobach medycznych, o następującym składzie i parametrach:

Podłączenie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, bezpudrowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 x 45 cm
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowe, 17-nitkowe

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 x 7 cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2 szt.) opatrunek w postaci przylepca 1,25 x 14,8 cm

Rozłączenie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar M
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowe, 17-nitkowe
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm (zapakowany)

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie). Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121 - dot. Pakietu 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 - dot. Pakietu 10, poz. 7 - 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o bardzo wysokiej chłonności bez silikonowej warstwy kontaktowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 - dot. Pakietu 10, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 x 25 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 - dot. Pakietu 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji dłoni/ stopy posiadającego w swoim składzie serwetę główną 150 x 200 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 160 cm z dodatkowym elementem chłonnym o wym. 75x160cm, stanowiącą owinięcie zestawu? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 285%.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 - dot. Pakietu 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, spełniającego definicje MDR i ustawę o wyrobach medycznych, posiadającego serwetę operacyjną w rozmiarze 200x300cm (pad 75x75cm) i otwór decentralny 15x15cm oraz serwetę na stół narzędziowy nieprzylepną 150x190cm jako owinięcie zestawu? Zestawu wykonanego z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350% w strefie krytycznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 - dot. Pakietu 19, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra, w którym: serweta na stolik instrumentariuszki jest w rozmiarze 190 x 150cm i posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm; serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie min. 60 x 145 cm; serweta główna ma rozmiar 335x280/225cm z otworem samouszczelniającym 21x18cm i posiada wzmocnienie min. 60 x 135 cm; serweta pomocnicza ma rozmiar 150 x 200 cm (w miejsce serwety 150 x 150 cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 - dot. Pakietu 19, poz. 4

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, spełniającego definicje MDR i ustawę o wyrobach medycznych, posiadającego w swoim składzie opatrunek pooperacyjny włókninowy 20x8cm (zamiast kompresu z włókniny 10x10cm) oraz pojemnik na igły i skalpele 15/15 miejsc magnetyczny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 - dot. Pakietu 19, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy 17nitkowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 - dot. Pakietu 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych posiadających przy szyi wykończenie typu V oraz dostępnych w dwóch różnych kolorach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 - dot. Pakietu 25, poz. 8

Ze względu na wycofanie ze sprzedaży pęsety anatomicznej typu Jansen czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety prostej typu DeBakey w rozmiarze 15,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 - dot. Pakietu 25, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego, spełniającego definicje MDR i ustawę o wyrobach medycznych, posiadającego w swoim składzie kleszczyki anatomiczne Halstead Mosquito zakrzywione 12,5 cm, stalowe jednorazowe (zamiast kleszczyków typu pean zakrzywione, 12,5cm), kompresy gazowe 17-nitkowe (zamiast 13-nitkowych) oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze min.75 x 75 cm (zamiast serwety w rozmiarze 75x145cm)? Dodatkowo zestaw może posiadać imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm, stalowe jednorazowe? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie