

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI) ORAZ ZMIANY W SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych artykułów medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ-ZP-1/2023

Pytanie nr 1 Pakiet 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze 28-34(+/- 2cm)?

Odpowiedź nr 1

Tak, zamawiający dopuści okulary w rozmiarze 28-34(+/- 2 cm)

Pytanie nr 2 do pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, dzieloną, dla dorosłych, jednorazowego użytku z przyłączem, bez kabla przyłączeniowego, powierzchnia całkowita (z pierścieniem okalającym) 110cm², czytelne piktogramy, naklejki IAG, pakowane po 5 szt. w opakowaniu, opakowanie zbiorcze po 100 szt. Kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną firmy ERBE.

Odpowiedź nr 2

Brak zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 3

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 36 mm (z języczkiem 42mm), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 7 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie wyceny op. = 1 szt. (rolka) z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź nr 5

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 7 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie wyceny op. = 1 szt. (składanka) z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź nr 6

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Pakiet nr 7 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 114 mm x 150 mm x 66 kartek.

Odpowiedź nr 7

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Pakiet nr 7 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 mm x 100 mm x 150 kartek.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Pakiet nr 7 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do aparatu TENS o rozmiarze 9,6 x 5,3 cm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 9

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Pakiet nr 7 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepak 20 o rozmiarze 50 mm x 30 mm.

Odpowiedź nr 10

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 7 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepak12 o rozmiarze 107 mm x 23 mm.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 PAKIET 8, poz. 5

W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyroby inne niż chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane produkty opisane w pakiecie 8. Poz. 5

2. Jeśli w pakiecie 8. poz. 5 Zamawiający oczekuje innych wyrobów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający oczekuje wyrobów zgodnych z normą EN 13795, do stosowania w gabinetach zabiegowych i na bloku operacyjnym.

Pytanie nr 13 PAKIET 8, poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 PAKIET 8, poz. 9-10

Czy Zamawiający wydzieli poz. 9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź nr 15

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 16 PAKIET 11, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź nr 16

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 17 PAKIET 11, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,45 x 13?

Odpowiedź nr 17

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 18 PAKIET 11, poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,33 x 13 mm zamiast 0,4 x 13. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 18

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 19 PAKIET 11, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13?

Odpowiedź nr 19

Wykonawca nie doprecyzował pytania, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 20 PAKIET 11, poz. 21-22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie motylków w rozmiarze 0,6 x 20, 0,7 x 20 ?

Odpowiedź nr 20

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 21 PAKIET 11, poz. 26-28

Czy Zamawiający wydzielił poz. 26-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Czy w Pakiecie nr 12 w poz. 2 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź nr 22

Tak, zamawiający wymaga zweryfikowanej klinicznie efektywności.

Pytanie nr 23

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 12 poz. 2 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na

wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną, dla dorosłych oraz dla dzieci o wadze od 2kg , jednorazowego użytku z przyłączem, bez kabla przyłączeniowego, pierścień ekwipotencjalny 21cm³, powierzchnia 87cm², opakowanie zbiorcze po 50szt . Kompatybilne z datermią elektorchirurgiczną firmy ERBE ?

Odpowiedź nr 24

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści możliwość składnia ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 11?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 11.

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakiet nr 20 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod neutralnych z pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23 cm² oraz powierzchni czynnej 85 cm², pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 26

Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 27

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 4 do SWZ, Pakiet 22
Z uwagi na fakt, iż w pakiecie 22 Zamawiający umieścił narzędzia z dwóch różnych dziedzin medycyny, co istotnie ogranicza konkurencyjność tego postępowania przetargowego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z niniejszego pakietu pozycji 1 oraz 10 do oddzielnych zadań.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 4 do SWZ, Pakiet 22
Czy Zamawiający w pakiecie 22, poz. 2 dopuści kleszcze chwytające o średnicy cewnika 2,3 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź nr 28

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 29

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-1/2023, § 2 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszego ust. o następującą treść:

(...) na towar wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni, licząc od dnia powzięcia powyższej wiadomości (w przypadku ujawnienia w dostarczonym towarze braków ilościowych lub jakościowych) pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź nr 29

Zapis ma prawidłową formułę a zaproponowana zmiana jest nieczytelna i nie wskazuje do jakiej reklamacji się odnosi.

Pytanie nr 30

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-1/2023, § 6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego do dodanie do niniejszego ust. poniższego zapisu:

(..) Zgody laskiej nie Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu jak wyżej.

Pytanie nr 31

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ ZP 1/2023, § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-1/2023, § 7 ust. 1, 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych odpowiednio

1. z 1,0 % na 0,5 % ?

2. z 10 % na 5 % ?

Odpowiedź nr 32

Kary umowne określone w treści projektu umowy nie są zawyżone, wobec czego brak jest zasadności ich zmniejszania.

Pytanie nr 33 Pakiet 18

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości szwu 65 mm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości szwu 85 mm, bez indeksu U.
3. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie staplerówze zszywkami o szerokości 4,5 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie endobagów laparoskopowych o rozmiarze worka 85 mm (szerokość)x185 mm (długość), z cyfrowym oznakowaniem pojemności na opakowaniu.

5. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie endobagów laparoskopowych o rozmiarze worka 160 mm (szerokość) x200 mm (długość), z cyfrowym oznakowaniem pojemności na opakowaniu.

Odpowiedź nr 33

1. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z OPZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z OPZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z OPZ.
4. Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 34 Pakiet 22

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm.
3. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

Odpowiedź nr 34

1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o szerokości ostrza 36 mm w przypadku gdy strzygarka kompatybilna z nimi posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele.

W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które uczynimy bezpłatnie na czas trwania umowy.

Odpowiedź nr 35

Tak, zamawiający dopuszcza pod warunkiem bezpłatnego użyczenia strzygarek na czas trwania umowy.

Pytanie nr 36 Pakiet nr 2

Poz. 4-5

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cyt. „igły do wkłuć podpajęcznych typu Spinal bez prowadnicy” - tak jak obecnie stosowane - to igły, które posiadają wygodny w użyciu owalny uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę ze srebrnej - natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 36

Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 37 Pakiet nr 2 Poz. 7

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do punkcji lędźwiowych, o dł. 127mm, - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 38 Pakiet nr 6

Poz. 1-8

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania z kolorowym nieprzeźroczystym konektorem - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania - tak jak obecnie stosowane - powinny poza wymaganym w SWZ kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, posiadać także oznaczenie numeryczne, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź nr 38

1. Tak, zamawiający dopuszcza.
2. Tak, zamawiający potwierdza

Pytanie nr 38 Pakiet nr 6 Poz. 9-17

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „silikonowany” oznacz wymóg zaferowania cewników, które wykonane są z wysokiej jakości lateksu, pokrytego zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego - tak jak w obecnie stosowanych.
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Foleya z balonem o pojemności balonu opisywanej przez producenta jako 5-15ml - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 38

1. Tak, zamawiający potwierdza.
2. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 Pakiet nr 6 Poz. 26

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Pezzera - tak jak obecnie stosowane – powinny posiadać zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi, zapewniające skuteczny drenaż - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Pezzera o standardowej długości 400mm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 39

1. Tak, zamawiający potwierdza.
2. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 Pakiet nr 6 Poz. 36-38

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki ustno-gardłowe Guedela, wykonane z równoważnego do wskazanego w SWZ materiału, bez zawartości ftalanów i lateksu - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela - tak jak obecnie stosowane - to jednoelementowe, w pełni bezpieczne w użytkowaniu rurki ustno-gardłowe z równoważnym kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, ułatwiającym ich identyfikację, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 40

1. Tak, zamawiający potwierdza.
2. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 Pakiet nr 6 Poz. 39-43

1. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowe rurki intubacyjne to rurki z mankietem niskociśnieniowym - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowe rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać wyraźne czytniki głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego powinien być w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 41

1. Tak, Zamawiający potwierdza.
2. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 42 Pakiet nr 6 Poz. 51-53

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym zbrojone - tak jak obecnie stosowane - powinny być wyposażone w prowadnicę, ułatwiająca wykonanie procedury, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 42

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43 Pakiet nr 6 Poz. 54-57

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym - tak jak obecnie stosowane - powinny analogicznie do rurek intubacyjnych być wykonane z PCV silikonowanego, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 43

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 44 Pakiet nr 6 Poz. 64

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „zastawka antyzwrotna”, to zastawka zamykająca automatycznie drogę wycieku płynu po odłączeniu strzykawki i wbudowana w korpus przyrządu - tak jak w obecnie stosowanych

tego typu mini-spike'ach, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy typu Mini-Spike - tak jak obecnie stosowane - powinny jako wyroby do długiego użytkowania być oznaczone na samym wyrobie min. logo lub nazwą producenta, co pozwala na ich precyzyjną identyfikację w każdym momencie ich użytkowania klinicznego /także po wyjęciu z opakowania jednostkowego/, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 44

1. Tak, zamawiający potwierdza.
2. Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45 Pakiet nr 6 Poz. 65

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne katetery do odsysania ran typu Redon - tak jak obecnie stosowane - bez kontrastu RTG lub opcjonalnie z kontrastem RTG, dla rozmiaru Ch 14 pakowane a 20szt. /pozostałe rozmiary pakowane zgodnie z wymogami/ spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 45

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 Pakiet nr 6 Poz. 68

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne butelki wysokociśnieniowe - tak jak obecnie stosowane - o ciśnieniu początkowym wyrażonym w równoważnych jednostkach (mmHg) na poziomie 700 lub 400mmHg do wyboru przez Zamawiającego, z drenem łączącym o długości tolerancji +/-20cm, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane butelki wysokociśnieniowe - tak jak obecnie stosowane – powinny posiadać wyraźny (cyfrowy), skalowany czytnik poziomu zassania, co zapewnia kontrolę nad prawidłowym przebiegiem prowadzonego drenażu.

Odpowiedź nr 46

1. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
2. Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47 Pakiet nr 6 Poz. 69-70

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „z linią widoczną w rtg”, oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych - tak jak w obecnie stosowanych cewnikach.

Odpowiedź nr 47

Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 48 Pakiet nr 6 Poz. 72

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do kaniulacji dużych naczyń- dwukanałowe - tak jak obecnie stosowane - z przewodnicą niklową lub stalową, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 48

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 Pakiet nr 6 Poz. 73

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne plastry do mocowania venflonów z tolerancją rozmiaru +/- 0,5cm, pakowane w opakowania a 50szt. lub 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 49

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 Pakiet nr 6 Poz. 74

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne poliuretanowe opatrunki do mocowania venflonów w rozmiarze 7 x 8,5cm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane poliuretanowe opatrunki do mocowania kaniul - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać wycięcie, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramkę, metkę i min 2 paski mocujące, powinny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, oraz powinny posiadać potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 50

1.Tak,zamawiający dopuszcza.

2.Tak,zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 51 Pakiet nr 6 Poz. 75

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane transparentne opatrunki do wkłuc centralnych - tak jak obecnie stosowane - powinny być pakowane w opakowanie typu folia-folia, powinny posiadać klej akrylowy, wzmocnione włókniną od spodu obrzeże, ramkę, metkę i szeroki pasek mocujący z wycięciem, powinny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol oraz powinny posiadać potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 51

Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 52 Pakiet nr 6 Poz. 76

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix z workiem o pojemności 2l - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 52

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 Pakiet nr 6 Poz. 79

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać długość min. 100cm, skalowanie co min. 5cm oraz czynniki rtg na proksymalnym i dystalnym końcu balonów: przelykowym i żołądkowym, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na sondy Sengstakena - tak jak obecnie stosowane - wykonane z medycznego pcv (balony lateksowe), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 53

1. Tak, zamawiający potwierdza.
2. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 Pakiet nr 6 Poz. 83-84

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny do masywnego drenażu ran - tak jak obecnie stosowane - wykonane z silikonowanego tworzywa z 7 otworami do odbierania wydzieliny optymalnie rozłożonymi na długości ok. 10 cm, bez linii kontrastującej w RTG lub opcjonalnie z linią, w rozmiarach odpowiednio: 34F dla poz. 83 oraz 38F dla poz. 84, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 54

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55 Pakiet nr 10 Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne obwody oddechowe do aparatu do znieczuleń gładkie w środku lub rozciągane - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie istnieją obwody jednocześnie gładkie w środku i rozciągane, tak jak to wynika z literalnego zapisu SWZ.

Odpowiedź nr 55

Zamawiający dopuszcza karbowane.

Pytanie nr 56 Pakiet nr 10 Poz. 16

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przestrzenie martwe - tak jak obecnie stosowane - powinny być sterylne, rozciągliwe /długość 7/16cm/, powinny posiadać podwójnie obrotowy łącznik z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, oraz standardowe złącza 15M-22M/15F.

Odpowiedź nr 56

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57 Pakiet nr 10 Poz. 17

1. W związku z zaprzestaniem produkcji zestawów do drenażu opłucnej o nazwie handlowej Pleurofix firmy B/Braun (opisanego w SWZ) - prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy, składające się z: Igła Veresa 16G z zaworem kulkowym automatycznie zamykającym światło cewnika podczas wysuwania igły, wyposażona w zawór jednokierunkowy

wentylowy zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwukolorowy wskaźnik bezpieczeństwa, strzykawka Luer-Lock 50ml, kaniula drenażowa z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła veresa. zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle w rozmiarze 8F/CH, światowego lidera w ich produkcji.

Odpowiedź nr 57

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 Pakiet nr 10 Poz. 19

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry, to filtry mechaniczne - tak jak obecnie stosowane - które powinny charakteryzować się poza skutecznością filtracji dla bakterii na poziomie wskazanym w SWZ, także skutecznością filtracji dla wirusów na poziomie min. 99,9999% oraz skutecznością filtracji wobec NaCl na poziomie min. 99,76%, przy wadze własnej do maks. 49g oraz przestrzeni martwej maks. do 96ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 58

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 10 Poz. 23

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne łączniki VacSax w kolorze czarnym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 59

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 Pakiet nr 13 Poz. 9

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w maskownicy, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną (kolorystyczną) o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiającą szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi, co zapewnia ich w pełni bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź nr 60

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61 Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści woreczek bez gąbki, gdyż stwarza ona ryzyko zanieczyszczenia próbki bakteriami

Odpowiedź nr 61

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 62 Pakiet 1, poz. 4,5,6,8,14,15,17,35,39

Czy zamawiający wydzieli poz. 4,5,6,8,14,15,17,35,39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie

publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63 Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64 Pakiet 1 poz.14 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 64

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65 Pakiet 3, poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 65

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 Czy zamawiający wydzielił poz. 10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67 Pakiet 3, poz. 10

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer – Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 Pakiet 3, poz. 11

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź nr 68

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 Pakiet 5, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 Pakiet 5, poz. 2,7,8,10

Czy zamawiający wydzieli poz. 10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 70

zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71 Pakiet 8, poz. 8

Czy zamawiający dopuści komplet z bluzą posiadającą wycięcie półokrągłe pod szyją?

Odpowiedź nr 71

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 Pakiet 8, poz. 9

1.Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

2.Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

3.Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

4.Czy dopuści perforację co 38 cm?

5.Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr 72

1.Zamawiający nie dopuści.

2.Nie,zamawiający nie dopuści.

3.Tak,zamawiający dopuści.

4.Tak,zamawiający dopuści.

5.Tak,zamawiający dopuści.

Pytanie nr 73 Pakiet 8, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli

na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 73
zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74 Pakiet 11, poz. 1-2,9-11
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 74
zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75 Pakiet 11, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 75
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 76 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 3
Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 3 staplera liniowego z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, dł. linii szwu 60mm, 80mm, 100mm do tkanek normalnych (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubych (wysokość zszywki 4,5 mm), sterylny. Rozmiary 60, 80, 100

Odpowiedź nr 76
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 4
Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 4 ładunków do staplera liniowego z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, dł. linii szwu 60mm, 80mm, 100mm do tkanek normalnych (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubych (wysokość zszywki 4,5 mm), sterylny. Rozmiary 60, 80, 100

Odpowiedź nr 77
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 5
Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 5 staplera okrężnego w rozmiarze 28 mm

Odpowiedź nr 78
Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 7

Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 7 endobaga laparoskopowego o średnicy 54 mm i długości 200 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 8

Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 8 endobaga laparoskopowego o średnicy 100 mm i długości 205 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 80

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 9,10,12

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga aby klipsy były wyposażone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie: z jakiego materiału klips wykonany; nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; oraz datę ważności produktu?

Odpowiedź nr 81

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 12

Prosimy o informację, czy w odniesieniu do wyspecyfikowanych w tym zadaniu klipsów, Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia przez producenta, że oferowane klipsy spełniają wymagania określone dla implantów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie badaniu pacjenta w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź nr 82

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 Pakiet nr 6 Poz. 32

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do podawania tlenu - tak jak obecnie stosowane - pakowane w opakowania foliowe, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do podawania tlenu o długości 150cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 83

1.Tak,zamawiający dopuszcza.

2.Tak,zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do pobierania wymazów o długości min. 150mm?

Odpowiedź nr 84

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 85 Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do pobierania wymazów o długości min 150mm?

Odpowiedź nr 85

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 86 Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek na wymioclony wyposażony w funkcję „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?

Odpowiedź nr 86

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 87 Pakiet nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 30ml?

Odpowiedź nr 87

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 88 Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną o długości min. 14cm?

Odpowiedź nr 88

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 89 Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną o długości min. 25cm?

Odpowiedź nr 89

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 90 Pakiet nr 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kankę o długości 9cm?

Odpowiedź nr 90

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91 Pakiet nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający doprecyzuje czy miał na myśli 4 opakowania po 5 sztuk?

Odpowiedź nr 91

Tak, 4 opakowania po 5 sztuk.

Pytanie nr 92 Pakiet nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę rurek doodbytniczych za sztukę?

Odpowiedź nr 92

Tak, zamawiający dopuści z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 93 Pakiet nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm, wymiarach 100mm x 55mm oraz średnicy otworu wyrzutowego 37mm?

Odpowiedź nr 93

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 94 Pakiet nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm, średnicy dolnej 102mm oraz średnicy otworu wyrzutowego 60mm?

Odpowiedź nr 94

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 95 Pakiet nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 160mm, średnicy górnej 165mm, średnicy dolnej 120mm oraz średnicy otworu wyrzutowego 70mm?

Odpowiedź nr 95

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 96 Pakiet nr 1, pozycja 24-27

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z PP?

Odpowiedź nr 96

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 97 Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?

Odpowiedź nr 97

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 98 Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?

Odpowiedź nr 98

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 99 Pakiet nr 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 520ml?

Odpowiedź nr 99

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 100 Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1200ml?

Odpowiedź nr 100

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 101 Pakiet nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300ml?

Odpowiedź nr 101

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 102 Pakiet nr 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści basen wyłącznie w kolorze białym?

Odpowiedź nr 102

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 103 Pakiet nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści ścierki o wymiarach 40x40cm?

Odpowiedź nr 103

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 104 Pakiet nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści niesterylne ścierki o wymiarach 30x33cm, pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź nr 104

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 105 Pakiet nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wielorazowego użytku, do dezynfekcji?

Odpowiedź nr 105

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 106 Pakiet nr 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści butelkę o parametrach:

- wąska butelka zapewnia dziecku komfort karmienia
- butelka posiada innowacyjny system antykolkowy, który zmniejsza występowanie kolek, odbijania oraz gazów
- butelkę można używać z systemem lub bez
- pasuje do większości laktatorów
- łatwa w czyszczeniu
- poj. 60ml i 120ml
- Nie zawiera BPA, PVC, ołowiu i ftalanów

Odpowiedź nr 106

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 107 Pakiet nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 88mm?

Odpowiedź nr 107

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 108 Pakiet nr 2, pozycja 4-5


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł typu Quinckie?

Odpowiedź nr 108

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 109 Pakiet nr 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z prowadnicą?

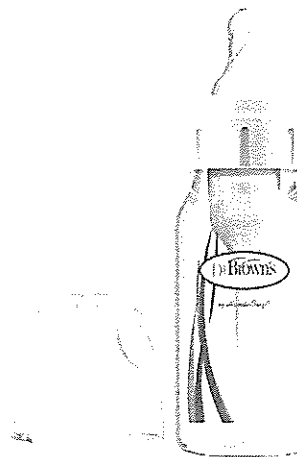

Odpowiedź nr 109
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 110 Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź nr 110
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 111 Pakiet nr 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 25Gx120mm?

Odpowiedź nr 111
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 112 Pakiet nr 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź nr 112
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 113 Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worek w kolorze czarnym, z zapięciem na zamek?


Odpowiedź nr 113
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 114 Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści w opakowaniu dodatkowo 1 parę rękawiczek?

Odpowiedź nr 114
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 115 Pakiet nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml?

Odpowiedź nr 115
Tak, zamawiający dopuści.

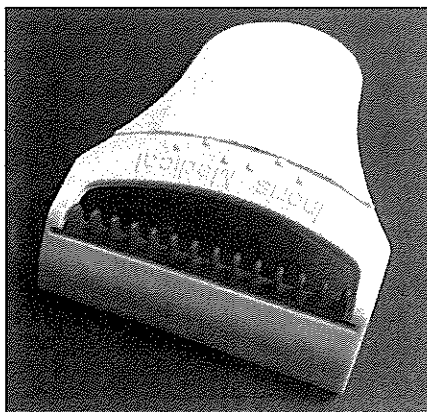

Pytanie nr 116 Pakiet nr 5, pozycja3

Czy Zamawiający dopuści golarkę medyczną golarkę medyczną jednorazowego użytku służącą do przygotowania pola operacyjnego przed zabiegami. Wykonana z tworzywa HIPS (polistyren wysokiej udarności), posiada pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej, które pokryte jest warstwą PTFE (teflon, platynium, diamond). Dodatkowo w prosty sposób ostrze można odłamać od ręczki poprzez lekki pionowy nacisk. Golarka wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany grzebień

zapobiegający zapychaniu się ostrza, opakowanie indywidualne: foliowe, jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź nr 116

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 117 Pakiet nr 5, pozycja4

Czy Zamawiający doprecyzuje czy ma na myśli 500 opakowań czy 500 sztuk myjek? Jeżeli Zamawiający miał na myśli faktycznie opakowanie, prosimy o doprecyzowanie po ile pakowane są myjki w OPZ.

Odpowiedź nr 117

500 opakowań pakowane po 8 sztuk. Zamawiający dopuści pakowane po 10 lub 20 sztuk z przeliczeniem na odpowiednie ilości.

Pytanie nr 118 Pakiet nr 5, pozycja4

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 118

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 119 Pakiet nr 5, pozycja5

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 119

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 120 Pakiet nr 5, pozycja6

Czy Zamawiający dopuści obwód mankietu 26-36 cm?

Odpowiedź nr 120

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 121 Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 71x120cm lub 70x117cm?

Odpowiedź nr 121

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 122 Pakiet nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający wymaga aplikatora gąbkowego nasączonego substancją odświeżającą i nawilżającą?

Odpowiedź nr 122

Zgodnie z SWZ, nie wymaga.

Pytanie nr 123 Pakiet nr 10, pozycja1

Czy Zamawiający doprecyzuje jakiego obwodu wymaga, ponieważ nie występuje obwód gładki w środku rozciągliwy? Na rynku występują 2 rodzaje obwodów: karbowany rozciągliwy oraz gładki w środku (karbowany na zewnątrz) o stałej długości.

Odpowiedź nr 123

Zamawiający miał na myśli obwód karbowany, rozciągliwy.

Pytanie nr 124 Pakiet nr 10, pozycja6-9

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z polichlorku winylu?

Odpowiedź nr 124

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 125 Pakiet nr 10, pozycja10

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną z polichlorku winylu?

Odpowiedź nr 125
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 126 Pakiet nr 10, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarze 1 o anatomicznym kształcie?

Odpowiedź nr 126
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 127 Pakiet nr 10, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarze 0 o kształcie kropli, z pompowanym mankietem?

Odpowiedź nr 127
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 128 Pakiet nr 10, pozycja 11


Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą maskę anestetyczną?

Odpowiedź nr 128
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 129 Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną z polichloru winylu?

Odpowiedź nr 129
Zamawiający nie dopuści.

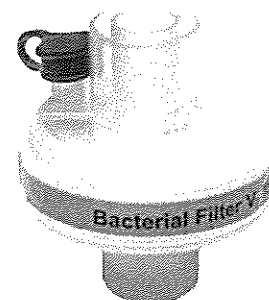

Pytanie nr 130 Pakiet nr 10, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak


Odpowiedź nr 130

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 131 Pakiet nr 10, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

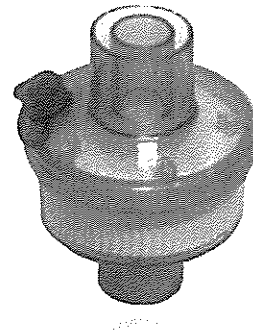

Odpowiedź nr 131

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 132 Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o długości 150mm w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź nr 132

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 133 Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę woreczków do pobierania próbek moczu pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 133

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 134 Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 134

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 135 Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny wyposażony w specjalne nacięcie

umożliwiający zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepek” zamiast zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź nr 135

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 136 Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie zaciskaczy pakowanych a'50 sztuk?

Odpowiedź nr 136

Błąd pisarski-zamawiający zamawia 650 sztuk (tj. 13 opakowań po 50 sztuk)

Pytanie nr 137 Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pojemników na mocz pakowanych a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź nr 137

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 138 Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 25 ml?

Odpowiedź nr 138

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 139

Pakiet 1, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 18ml lub 25 ml?

Odpowiedź nr 140

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 141 Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opaski dla noworodków i niemowląt o długości 17,5 cm?

Odpowiedź nr 141

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 142 Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opaski dla dorosłych o długości 25 cm?

Odpowiedź nr 142

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 143 Pakiet 1, pozycja 14-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opasek pakowanych a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 143

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 144 Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw do lewatywy z drenem 115cm z zaciskiem przesuwным zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką oraz workiem o pojemności 1500m?

Odpowiedź nr 144

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 145 Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy z drenem 150cm z zaciskiem przesuwным zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką oraz workiem o pojemności 1750m?

Odpowiedź nr 145

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 146 Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne z atraumatycznym, lekko zaokrąglonym zamkniętym końcem dystalnym, który umożliwi precyzyjne wprowadzenie oraz z dwoma otworami bocznymi o łagodnych krawędziach?

Odpowiedź nr 146

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 147 Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z otworem centralnym, bez otworów bocznych?

Odpowiedź nr 147

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 148 Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę czy opakowanie a'5 sztuk?

Odpowiedź nr 148

Wycena za opakowanie po 5 sztuk.

Pytanie nr 149 Pakiet 1, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu?

Odpowiedź nr 149

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 150 Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 0,7l wysokość 97mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 93mm?

Odpowiedź nr 150

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 151 Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 1l wysokość 140mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 92,5mm?

Odpowiedź nr 151

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 152 Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 2l wysokość 246mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 95mm?

Odpowiedź nr 152

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 153 Pakiet 1, pozycja 24-27

Prosimy o doprecyzowanie – co Zamawiający ma na myśli oczekując pojemników zadrukowanych? Czy pojemniki mają być nieprzezroczyste, posiadać dodatkową etykietę czy jak interpretować ten wymóg?

Odpowiedź nr 153

Pojemniki z dodatkową etykietą.

Pytanie nr 154 Pakiet 1, pozycja 24-27

Jeżeli zadrukowanie oznacza etykietę czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników bez etykiety lub z dodatkową, dołączoną etykietą do naklejenia?

Odpowiedź nr 154

Tak, z dołączoną dodatkową etykietą.

Pytanie nr 155 Pakiet 1, pozycja 24-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polietylenu?

Odpowiedź nr 155

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 156 Pakiet 1, pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polipropylenu?

Odpowiedź nr 156

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 157 Pakiet 1, pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2300 ml?

Odpowiedź nr 157

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 158

Pakiet 1, pozycja 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź nr 158

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 159 Pakiet 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki do osuszania rąk w rozmiarze 40x40cm, wykonane z włókniny typu spunlance?

Odpowiedź nr 159

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 160 Pakiet 1, pozycja 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 160

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 161 Pakiet 1, pozycja 32 i 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 161

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 162 Pakiet 1, pozycja 38

Jakiej Firmy butelek Zamawiający używał dotychczas?

Odpowiedź nr 162

Butelki kompatybilne ze smoczkiem Nutricia Standard

Pytanie nr 163 Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 26G 0,45x90 mm?

Odpowiedź nr 163

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 164 Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 25Gx90 mm?

Odpowiedź nr 164

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 165 Pakiet 3, pozycja 1, 3-9

Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu i 4 paskami rtg?

Odpowiedź nr 165

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 166 Pakiet 3, pozycja 1, 3-9

Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z poliuretanu i 6 paskami rtg?

Odpowiedź nr 166

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 167 Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,7x19?

Odpowiedź nr 167

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 168 Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez portu, z cewnikiem wykonanym z teflonu, o przepływie 17ml/min?

Odpowiedź nr 168

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 169 Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32?

Odpowiedź nr 169

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 170 Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32?

Odpowiedź nr 170

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 171 Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści korki luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi, w kolorze białym?

Odpowiedź nr 171

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 172 Pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu?

Odpowiedź nr 172

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 173 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki zamykane na zamek, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 173

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 174 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki czarne, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 174

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 175 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków pakowanych a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 175

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 176 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml?

Odpowiedź nr 176

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 177 Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 177

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 178 Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'1szt czy a'50szt?

Odpowiedź nr 178

Wycena za op.50 sztuk.

Pytanie nr 179 Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające splukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbát 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk.Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny?

Odpowiedź nr 179

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 180 Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'8 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 180
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 181 Pakiet 5, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 181
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 182 Pakiet 5, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 182
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 183 Pakiet 5, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 183
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 184 Pakiet 6, pozycja 2-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika jałowego do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 naprzemianległymi otworami z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź nr 184
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 185 Pakiet 6, pozycja 2-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości 50cm?

Odpowiedź nr 185
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 186 Pakiet 6, pozycja 9-10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika z balonem 3-5ml spełniającego pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 186
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 187 Pakiet 6, pozycja 18-25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź nr 187
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 188 Pakiet 6, pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika Pezzer o rozm. 32F/40cm?

Odpowiedź nr 188

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 189 Pakiet 6, pozycja 27-31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnika o długości 105cm?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr 189

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 190 Pakiet 6, pozycja 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika pakowanego w opakowanie foliowe?

Odpowiedź nr 190

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 191 Pakiet 6, pozycja 36-38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurki pakowanej w opakowanie foliowe?

Odpowiedź nr 191

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 192 Pakiet 6, pozycja 39-53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurek intubacyjnych wykonanych z termoplastycznego PVC niesilikonowanego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr 192

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 193 Pakiet 6, pozycja 39-50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurki pakowanej w opakowanie typu banan zapewniające utrzymanie jej anatomicznego kształtu?

Odpowiedź nr 193

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 194 Pakiet 6, pozycja 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łączników o średnicy wewnętrznej 6mm?

Odpowiedź nr 194

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 195 Pakiet 6, pozycja 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu do pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,1 µm oraz bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź nr 195
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 196 Pakiet 6, pozycja 65, 81-84
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Redona zwijanego, z krzyżową perforacją o długości 14cm?

Odpowiedź nr 196
Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 197 Pakiet 6, pozycja 65, 81-84
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Redona zwijanego wykonanego z poliuretanu o właściwościach termoplastycznych, z naprzemienną perforacją o długości 15cm oraz o długości 80cm?

Odpowiedź nr 197
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 198 Pakiet 6, pozycja 69-70
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kateterów o długości 34 +/-1cm?

Odpowiedź nr 198
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 199 Pakiet 6, pozycja 65-66
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kateterów o długości 50cm?

Odpowiedź nr 199
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 200 Pakiet 6, pozycja 66
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolców pakowanych a'150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 200
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 201 Pakiet 6, pozycja 79
Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Odpowiedź nr 201
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 202 Pakiet 6, pozycja 85
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki z drenem Ch24?

Odpowiedź nr 202
Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 203 Pakiet 6, pozycja 86-87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z nieprzeźroczystymi konektorami?

Odpowiedź nr 203

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 204 Pakiet 6, pozycja 74

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź nr 204

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 205 Pakiet 6, pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź nr 205

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 206 Pakiet 8, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 206

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 207 Pakiet 8, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 207

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 208 Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), Spodnie z trokami w pasie, w kolorze niebieskim? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź nr 208
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 209 Pakiet 8, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 20m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 209
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 210 Pakiet 8, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 38cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź nr 210
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 211 Pakiet 8, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym (dł. 120cm, szer. 70cm, obwód 140cm)?

Odpowiedź nr 211
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 212 Pakiet 8, pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z wycięciem, wiązaną na troki pod szyją?

Odpowiedź nr 212
Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 213 Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź nr 213
Tak, zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 214 Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź nr 214
Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 215 Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem

(a nie zaciskiem szczelinowym), umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrzędu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

Odpowiedź nr 215

Tak, zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 216 Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrzędu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź nr 216

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 217 Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrzędu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź nr 217

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 218 Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Odpowiedź nr 218

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 219 Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrzędu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź nr 219

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 220 Pakiet 11, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 220

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 221 Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 221

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 222 Pakiet 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź nr 222

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 223 Pakiet 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź nr 223

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 224 Pakiet 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13?

Odpowiedź nr 224

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 225 Pakiet 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź nr 225

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 226 Pakiet 11, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o długości 1,5m i objętości wypełnienia 1,9ml?

Odpowiedź nr 226

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 227 Pakiet 11, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści standardowy przedłużacz do pomp o długości 2,0m?

Odpowiedź nr 227

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 228 Pakiet 12, pozycja 3-6

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź nr 228

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 229 Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczenia linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną

skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź nr 229
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 230 Pakiet 14, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź nr 230
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 231 Pakiet 14, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, składający się z czterech części:
- dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (100cm x 160cm i 80cm x 150cm)
- dwóch taśm (3cm x 100cm),
wykonany z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odpowiedź nr 231
Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 232 Pakiet 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr 232
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 233 Pakiet 16, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr 233
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 234 Pakiet 16, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 50cm x 75cm z otworem?

Odpowiedź nr 234
Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 235 Pakiet 16, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści 10szt. kompresów z gazy 13N 8W 7,5 x 7,5?

Odpowiedź nr 235
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 236 Pakiet 17, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr 236
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 237
Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1 dopuści przyrząd bez zaczepu na dren?

Odpowiedź nr 237
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 238
Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1dopuści opakowanie typu folia?

Odpowiedź nr 238
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 239
Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 5dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem do 2,5ml?

Odpowiedź nr 239
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 240

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 7 dopuści strzykawkę 10ml z rozszerzeniem do 11ml?

Odpowiedź nr 240

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 241

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 7 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem?

Odpowiedź nr 241

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 242

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 8 dopuści opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź nr 242

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 243

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 10 dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odpowiedź nr 243

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 244

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 9 dopuści tłok wykonany z polietylenu, a cylinder z polipropylenu?

Odpowiedź nr 244

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 245

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 11 dopuści op. a'25sztuk?

Odpowiedź nr 245

Tak, z przeliczeniem odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 246

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 13 dopuści igłę 0,45x13mm?

Odpowiedź nr 246

Tak, dopuści.

Pytanie nr 247

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści kaniule wykonaną z FEP w rozmiarze 26G 0,62x19mm?

Odpowiedź nr 247

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 248

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 2-7 dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź nr 248

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 249

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści kaniule w rozmiarze 22G 0,9x25mm?

Odpowiedź nr 249

Tak, dopuści.

Pytanie nr 250

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 4 dopuści kaniule w rozmiarze 20G 1,1x32mm?

Odpowiedź nr 250

Tak, dopuści.

Pytanie nr 251

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,3x45mm?

Odpowiedź nr 251

Tak, dopuści.

Pytanie nr 252

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 7 dopuści kaniule w rozmiarze 14G2,1x45mm?

Odpowiedź nr 252

Tak, dopuści.

Pytanie nr 253 PAKIET nr 16 Poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do znieczuleń o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta chirurgiczna włókninowa 75 x 90 cm
- 1 x serweta chirurgiczna włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm
- 5 x tampon z 100% gazy bawełnianej (tupfer), 20-nitkowa, wielkość śliwki

Odpowiedź nr 253

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 254 Pakiet nr 16 Poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do znieczuleń o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta chirurgiczna przylepna 60 x 75 cm, otwór przylepny typu romb 10 x 10 cm decentralnie

- 1 x serweta chirurgiczna na stół narzędziowy 75 x 45 cm (owinięcie zestawu)
- 3 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 6 warstw, 30g/m²
- 6 x tupfer z gazy Nr 4, 24 x 24 cm, 20 nitek
- 1 x strzykawka 2 ml Luer, 2 części, biała
- 1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części, biała
- 1 x igła iniekcyjna 18G, 1,20 x 40 mm
- 1 x igła iniekcyjna 25G, 0,50 x 38 mm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm

Odpowiedź nr

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 255

Wnosimy o odstąpienie od zapisów umowy w § 5 ust. 6 wzoru umowy lub przewidzenie mechanizmu zakupu interwencyjnego, w którym jego dokonanie będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do wykonania zobowiązania i wyznaczenia mu dodatkowego 5 dniowego terminu na dostawę zamówionego towaru?

Odpowiedź nr 255

Brak zgody.

Pytanie nr 256 Pakiet 4 poz. 1

W związku z zakończeniem produkcji Zestaw do pompy Flocare® 800 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do worków i butelek do pompy Flocare® Infinity™

Odpowiedź nr 256

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 257 Pakiet 15 (zestawy):

czy nie doszło do omyłki pisarskiej w załączniku nr 4 do SWZ, ponieważ w zakładce opisanej jako pakiet 15 znajduje się nagłówek „Pakiet 16”?

Odpowiedź nr

Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Błąd w nagłówki- zgodnie z zakładkami.

Pytanie nr 258 Pakiet 15(zestawy) poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny i organizerem na przewody (otwór 35 x 32 cm z folią chirurgiczną) 325 x250

1 podkład chłonny dla noworodka 90 x 60

4 serwetki do rąk włókninowe 40 x 20?

Odpowiedź nr 258

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 259 Pakiet 15(zestawy) poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 90 x 150

1 serweta pod pośladki z kieszenią 113 x 90
1 podkład chłonny dla noworodka 60 x 90
1 podkład chłonny 60 x 60
1 serwetka włókninowa 80 x 60
6 serwetek do rąk włókninowych 20 x 25?

Odpowiedź nr 259

Zamawiający nie dopuszcza Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 260 Pakiet 15 (zestawy)poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 Serweta chirurgiczna 45 x 75,
1 serweta chirurgiczna 60x50 z przyklepnym otworem o średnicy 10 cm i przyklepcami na dwóch rogach,
10 kompres włókninowy 30g 4 W 7,5/7,5,
1 pęseta plastikowa anatomiczna 13cm,
1 Opatrunek włók. z wkładem chłonnym 5cmx7,2,
1 Strzykawka 3 ml,
1 Strzykawka 5ml,
1 igła iniekcyjna 1,2x40mm
1 igła iniekcyjna 0,5x25mm?

Odpowiedź nr 260

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 261 Pakiet 15 (zestawy)poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 Serweta chirurgiczna 45 x 75,
1 serweta chirurgiczna 60x50 z otworem przyklepnym o średnicy 10 cm,
10 kompres włókninowy 30g 4 W 7,5/7,5,
1 Chwytnak plastikowy kleszcze pean 24 cm,
1 Opatrunek włók. z wkładem chłonnym 5cmx7,2,
1 Strzykawka 3 ml,
1 Strzykawka 5ml,
1 igła iniekcyjna 1,2x40mm
1 igła iniekcyjna 0,5x25mm?

Odpowiedź nr 261

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 262 Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 1 na 0,5% wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź nr 262

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.02.2023 r. oraz termin związania ofertą do dnia 28.03.2023 r.

I tak zapis w pkt. XVII SWZ o treści:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.03.2023r.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.03.2023r.

Zapis w pkt. XVIII SWZ o treści:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23.02.2023 r. do godziny 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 24.02.2023 r.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 27.02.2023 r. do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 28.02.2023 r.

Zmianie ulegają stosowne zapisy w Ogłoszeniu – sprostowanie zostaje załączone na stronie postępowania.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2, 3 i 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Zbigniew Kluczkowski
Prezes Zarządu
OCZ Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Ostrzeszowskie Centrum Zarządzania Sp. z o.o.
Zbigniew Kluczkowski